AlphaBio TEC
Simplantology

CATALOGO DE PRODUCTOS

2019

30 AÑOS
DE SIMPLANTOLOGÍA

INTRODUCCIÓN

4 Simplantología, ¡en todo lo que hacemos!
6 Soluciones de implantología inteligentes - Nuestro Portafolio
8 Superficie de implante Nanotec™
9 Paquete de implante avanzado

KITS, FRESAS Y HERRAMIENTAS

12 Kit quirúrgico
14 Kit de herramientas de cirugía guiada
15 Kit de topes
16 Línea de fresas revestidas
17 Fresas quirúrgicas y trépanos
18 Herramientas para la inserción de implantes
20 Herramientas de inserción de prótesis
21 Accesorios quirúrgicos

PLATAFORMAS DE IMPLANTE

CONEXIÓN STANDARD CÓNICA

24 Sistema de implantes NeO
25 Protocolo de fresado NeO
26 Herramientas de inserción
26 Pilares de cicatrización
27 Impresión
27 Moldeado de pilares
28 Restauración cementada
29 Restauración atornillada
32 Restauración de sobredentaduras
34 Restauración CAD/CAM - Nivel de implante
35 Restauración CAD/CAM - Nivel del pilar
35 CAD/CAM - Compatible con Sirona

CONEXIÓN HEXAGONAL CÓNICA

36 Sistema de implantes NeO
36 Protocolo de fresado NeO
37 Sistema de implantes NICE
37 Protocolo de fresado NICE
38 Herramientas de inserción
38 Pilares de cicatrización
39 Impresión
39 Moldeado de pilares
40 Restauración cementada
42 Restauración atornillada
44 Restauración de sobredentaduras
46 Restauración CAD/CAM - Nivel de implante
47 Restauración CAD/CAM - Nivel del pilar
47 CAD/CAM - Compatible con Sirona

CONEXIÓN HEXAGONAL INTERNA

48 Sistema de implantes NeO
49 Protocolo de fresado NeO
50 Sistema de implantes Spiral
51 Protocolo de fresado Spiral
52 Sistema de implantes ICE
53 Protocolo de fresado ICE
54 Sistema de implantes ATID
54 Protocolo de fresado ATID
55 Sistema de implantes DFI
55 Protocolo de fresado DFI
56 Herramientas de inserción
56 Pilares de cicatrización
57 Impresión
58 Restauración cementada
61 Moldeado de pilares
61 Tornillos protésicos
62 Restauración atornillada
64 Restauración de sobredentaduras
66 Restauración CAD/CAM - Nivel de implante
67 Restauración CAD/CAM - Nivel del pilar
67 CAD/CAM - Compatible con Sirona

APÉNDICES

68 Lista de productos y números de referencia
82 Garantía de Alpha-Bio Tec

SIMPLANTOLOGÍA EN TODO LO QUE HACEMOS!

En Alpha-Bio Tec, abordamos las necesidades de los profesionales dentales, aprovechamos nuestra experiencia y tecnologías, aplicamos el consejo de expertos, e invertimos en investigación, capacitación y educación. Todo esto da como resultado Simplantología: soluciones rentables que simplifican los procedimientos de implantología dental y ofrecen un éxito clínico comprobado.

ENTREGAMOS PRODUCTOS DE CALIDAD SUPERIOR Y DE USO FÁCIL

Hemos dominado el arte de simplificar la tecnología de implantes desarrollando un kit quirúrgico que se adapta a todos nuestros productos: implantes, pilares y herramientas quirúrgicas. Nuestro kit quirúrgico incluye instrumental quirúrgico básico y herramientas de terapia avanzada y es compatible con todos los sistemas de productos. Esto significa que se necesitan menos herramientas para lograr resultados exitosos. También simplifica el trabajo y minimiza las curvas de aprendizaje del profesional. Con una tasa de éxito clínico global del implante del 99,6% *, nuestros sistemas de implantes de alta calidad se basan en dos plataformas y tres conexiones, cada una con su propia línea de restauración de ajuste perfecto.

APROVECHAMOS LA EXPERIENCIA Y LAS TECNOLOGÍAS

Aprovechamos nuestra experiencia y tecnologías para garantizar que nuestros productos ofrezcan la mejor relación calidad-precio. Durante tres décadas, nos hemos centrado en el desarrollo y la fabricación de implantes dentales y sus derivados. Nuestro centro de fabricación de vanguardia, que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluye un departamento de control de calidad dedicado para garantizar los estándares y la calidad más altos posibles de nuestros productos y la provisión de una garantía de por vida para nuestros implantes dentales.

APLICAMOS INVESTIGACIÓN Y EL CONSEJO DE EXPERTOS

Nuestros equipos de I+D colaboran estrechamente con un panel internacional de expertos que tienen un amplio conocimiento clínico y académico. También invertimos en investigación preclínica in vivo, ensayos clínicos, estudios histológicos y estudios de laboratorio in vitro. Somos activos en todos los campos de investigación, incluida la investigación básica, los estudios preclínicos y los ensayos clínicos.

POSIBILITAMOS LA DIGITALIZACIÓN DEL MUNDO DENTAL

Creemos firmemente que compartir nuestros conocimientos y experiencia es fundamental para garantizar un trabajo de implantología exitoso y eficaz. Cada año, brindamos más de 150 cursos en todo el mundo, donde capacitamos a nuestros clientes sobre los últimos procedimientos de implantología dental y los métodos de flujo de trabajo. Los planes de estudio se basan en antecedentes teóricos y herramientas prácticas que abarcan una amplia gama de temas, como implantología básica, implantación y restauración inclinadas, regeneración guiada de huesos y tejidos, implantación inmediata y carga inmediata, cirugía guiada y flujos de trabajo digitales.

POSIBILITAMOS LA DIGITALIZACIÓN DEL MUNDO DENTAL

Abrazamos los cambios tecnológicos implicados en la digitalización del mundo dental para apoyar las necesidades presentes y futuras de nuestros clientes. En consecuencia, nuestra línea digital CAD/CAM ofrece una amplia gama de productos de restauración para nuestras tres conexiones de implantes. Además, nuestro kit de herramientas de cirugía guiada es compatible con los métodos de cirugía y permite a los dentistas seleccionar el software que se utilizará para planificar cirugías, haciendo su trabajo más simple, más preciso y mínimamente invasivo.

*Strietzel FP, Karmon B., Lorean A., Fischer PP Rehabilitación implantoprotésica del maxilar y mandíbula desdentados con datos preliminares de implantes cargados inmediatamente de un estudio retrospectivo, teniendo en cuenta el tiempo de implantación. JOMI La revista internacional de implantes orales y maxilofaciales 2011, V 26, 1: 139-147.

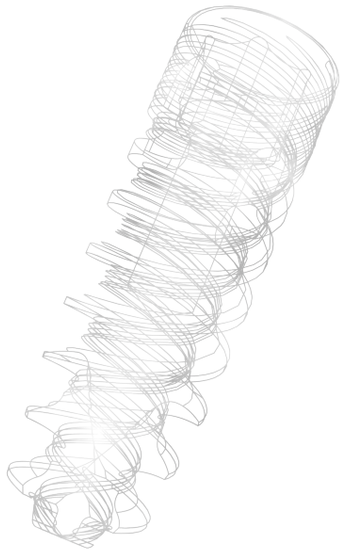

SISTEMAS DE IMPLANTES

Desde los implantes de conexión hexagonal interna hasta los implantes de conexión cónica, ofrecemos una gama completa de implantes, para que cada profesional pueda encontrar el implante preciso y más conveniente para trabajar, en cualquier momento.

PRÓTESIS Y CAD/CAM

Para cada una de nuestras conexiones de implantes, ofrecemos una amplia gama de opciones para cualquier necesidad clínica, incluyendo restauraciones fijas y removibles, prótesis atornilladas, cementadas y una amplia gama de piezas CAD/CAM. Los diámetros para cada parte protésica son intercambiables de acuerdo con la preferencia y necesidad. Todas las piezas están diseñadas para facilitar su uso y brindar una excelente apariencia estética.

INSTRUMENTACION QUIRÚRGICA

Nuestro kit quirúrgico universal es otra demostración del compromiso de Alpha-Bio Tec con la simplicidad. Este kit proporciona a los cirujanos todas las herramientas necesarias para realizar la mayoría de los procedimientos, desde marcar el punto de perforación hasta insertar el implante en su posición final. También se incluyen herramientas de orientación de implantes para la restauración final. Cada kit se puede personalizar para satisfacer las necesidades profesionales. Además, el kit de herramientas de cirugía guiada de Alpha-Bio Tec permite procedimientos de implante precisos y predecibles utilizando el software de planificación que elija el profesional.

SOLUCIONES INTELIGENTES EN IMPLANTOLOGÍA

Alpha-Bio Tec ha dominado el arte de incorporar implantes y prótesis basadas en implantes en la rutina diaria de los profesionales dentales, desarrollando productos que son sofisticados en su diseño y muy fáciles de usar.

	neo	Spiral*
CONEXIÓN	Hexagonal cónica, Hexagonal interna	Hexagonal interna
TIPOS DE HUESO	II, III, IV	III, IV
CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE DISEÑO	• Cónico • Pieza apical con características de centrado y anclaje • Dos micro espiras • Intercambio de plataforma	• Cuerpo condensador similar a un osteotomo • Núcleo cónico pronunciado • Parte apical con espiras profundas afiladas
BENEFICIOS CLÍNICOS	• Óptima estabilidad primaria • Alta conservación ósea • Micro espiras que aumentan en un 20%. • Aumento temprano del BIC	• Alta condensación ósea • Alta estabilidad inicial • Autoperforante • Capacidad de redireccionamiento durante la colocación • Penetración en diámetros pequeños

*Previamente conocido como SPI.

Nuestros sistemas de implantes cubren una amplia variedad de procedimientos quirúrgicos para todos los tipos de huesos: colocación inmediata o diferida de implantes, carga inmediata o diferida e implantación en crestas anchas o angostas.

Los implantes se basan en dos plataformas: de hexágono interno tradicional y cónica, que consta de dos conexiones: una conexión standard cónica (CS) y una conexión hexagonal cónica (CHC).

JICE	NICE	DFI	ATID
Hexagonal interna	Hexagonal Cónica	Hexagonal interna	Hexagonal interna
I, II, III, IV		I, II, III	I, II
• Moderadamente cónico • Conicidad invertida • Micro espiras coronales divididas		• Ligeramente cónico • Diseño de doble espira con espiras variables • Ápice con estrías de corte	• Cilíndrico • Paredes paralelas • Espiras uniformes • De amplia superficie
• Mejor distribución de lá presión • Soporta una amplia gama de casos clínicos • Penetración ósea controlada		• De fácil estabilización y control durante la colocación • Estabilidad a largo plazo • De amplia superficie	• BIC aumentado • Presión mínima sobre el hueso • Inserción homogénea

**Implantes ICE de Ø4,2, Ø4,65 y Ø5,3 en longitudes a partir de 10 mm.

SUPERFICIE DEL IMPLANTE

La investigación científica en todo el mundo ha demostrado que lograr una superficie de implante adecuada es la clave para alcanzar la oseointegración óptima. Está bien documentado que las características de la superficie de los materiales implantados influyen en gran medida en la curación y el crecimiento de los tejidos adyacentes a la superficie del implante.

Los implantes de Alpha-Bio Tec están hechos de **aleación de Titanio Ti 6Al 4V ELI**, un material fuerte, duradero y altamente biocompatible. Los años de intensa investigación y desarrollo llevaron a Alpha-Bio Tec a desarrollar la superficie superior del implante NanoTec™ para una osteointegración optimizada.

La superficie del implante NanoTec™ es de tipo híbrido y se logra a través de un proceso complejo que involucra partículas grandes (de 20 a 40 micrones) y un doble grabado térmico para la creación de microporos (de un tamaño de 1 a 5 micrones). Este proceso único crea una superfície altamente diferenciada, aumenta el área de superficie tridimensional (3D) y, por lo tanto, permite una absorción más intensa de proteínas de plasma y sangre directamente en los microporos del implante inmediatamente después de su colocación. La microestructura y las propiedades de rugosidad de la superficie del implante creadas por el proceso de arenado y doble grabado ácido, influyen en gran medida en el contacto inicial con el hueso huésped.

Las tecnologías de tratamiento de superficie de última generación en la planta de fabricación de Alpha-Bio Tec garantizan la aplicación con precisión del tratamiento de superficie.

NanoTec™ en combinación con el diseño Alpha-Bio Tec MICRO demuestra las siguientes ventajas:

- Promueve la oseointegración temprana
- BIC alto a largo plazo
- Mayor estabilidad secundaria
- Mayor predictibilidad

SEM de la superficie del implante



Aumento: X 1000



Aumento: X 3000

Histología del implante NeO*





* Referencias: Imágenes de microscopía óptica de la tinción histológica no descalcificada con azul de toluidina - fuchsina. Hueso parietal de mini cerdo Sinclair. El estudio se realizó en GLPigs, la Unidad de Investigación Pre-Clínica en el Centro Médico Assaf Harofeh, Israel. Las cirugías fueron realizadas por el Prof. Ofer Moses y el Dr. Omer Cohen (Universidad de Tel-Aviv, Israel). Histología realizada por el Prof. Dr. Dieter D. Bosshardt del Laboratorio de Histología Oral Robert K. Schenk, Universidad de Berna, Suiza.

PAQUETE DE VANGUARDIA

Nuestros sistemas de implantes vienen en un paquete sin montaje* y con destornilladores de agarre avanzados (consulte la página 18-19).

PAQUETE DE IMPLANTE

Un paquete moderno y fácil de usar, de diseño ergonómico para máximo confort.



ETIQUETAS DE IDENTIFICACION

La etiqueta indica el tipo de implante, longitud, diámetro y conexión (CHC / CS / IH).

L6 L8 L10 L11.5 L13 L16

SOPORTE CODIFICADO POR COLOR

Los soportes están codificados por colores para facilitar la identificación de la longitud del implante.

L6 L8 L10 L11.5 L13 L16

PATENTE PENDIENTE

PERMITE APILAR VARIOS PAQUETES JUNTOS

El diseño único permite apilar varios paquetes juntos para máxima eficiencia del espacio de almacenamiento.



1
Rasgue el cartón.

2
Levante la etiqueta del Tyvek®.

3
Retire el soporte interior.



4
Abra la tapa - operación fácil de una sola mano.

5
Inserte el destornillador de su preferencia y gire continuamente en sentido horario hasta encontrar el hexágono (la llave criquet es solo a efectos ilustrativos).

6
El implante se encuentra ahora conectado firmemente al destornillador y puede retirarse del envase con facilidad. Verifique que no haya espacio entre el destornillador y el implante.

7
El implante puede ser insertado directamente en el sitio.

8
Retire el tornillo de cierre con un destornillador protésico adecuado.

Nota: Actualmente disponible sólo con implantes NeO y ATID.

KITS, FRESAS Y HERRAMIENTAS

Alpha-Bio Tec se dedica a hacer que el trabajo de los profesionales dentales sea tan simple como sea posible. Por lo tanto, hemos desarrollado un kit universal con todas las herramientas necesarias para realizar la mayoría de los procedimientos clínicos. Cada kit se puede personalizar tanto en tamaño como en contenido de la bandeja para satisfacer las necesidades clínicas.

Además, todas las fresas y herramientas presentadas en este capítulo son compatibles con todos los sistemas de implantes y piezas protésicas (salvo que se indique lo contrario).

UN KIT PARA TODOS LOS SISTEMAS DE IMPLANTE

KIT QUIRÚRGICO

El kit quirúrgico de Alpha-Bio Tec es adecuado para todos los procedimientos y sistemas de implantes.

- Ergonómico, ligero y compacto, fácil de transportar.
- El diseño visual claro, codificado por colores, proporciona un acceso fácil e intuitivo.
- Marcas láser en la bandeja, con una barra de dimensiones para verificar con eficiencia la profundidad de las fresas.
- De fácil limpieza y esterilización en autoclave
- La caja y la bandeja están hechas de Radel®
- Baño de acero inoxidable
- Dimensiones de la caja: 19 cm x 14 cm x 6 cm

INFORMACIÓN DE PEDIDO: REF. NO. 4699

El kit se suministra vacío. Las herramientas y fresas deben pedirse por separado.

MINI KIT QUIRÚRGICO

Un diseño ligero y compacto para sus necesidades individuales.

- La caja y la bandeja están hechas de Radel®
- Baño de acero inoxidable
- Dimensiones de la caja: 10 cm X 8.5 cm X 5 cm

INFORMACIÓN DE PEDIDO:

REF. NO. 4611	Mini kit de fresas rectas
REF. NO. 4774	Mini kit de fresas escalonadas
REF. NO. 4775	Mini kit de fresas escalonadas sin plato

El kit se suministra vacío. Las herramientas y fresas deben pedirse por separado.

UN KIT PARA TODOS LOS SISTEMAS DE IMPLANTE

Un kit para todos los implantes

Opción de apertura con una sola mano

Fresas revestidas



Barra de dimensiones para verificar con eficacia la profundidad de las fresas

El kit se suministra vacío. Las herramientas y fresas deben pedirse por separado.

KIT DE HERRAMIENTAS DE CIRUGÍA GUIADA (GSTK)

- Kit quirúrgico ergonómico y de cuidado diseño.
- Incluye una variedad de fresas y herramientas en una bandeja modular.
- Los contenidos apoyan todo el procedimiento de cirugía guiada desde la preparación del sitio hasta la implantación final.
- Todos los componentes del kit se ajustan a los casquillos maestros correspondientes en la guía quirúrgica.

El kit no incluye llave.

FUNDAS

Las fundas están disponibles en varios diámetros y se utilizan en la fabricación de la guía quirúrgica.

	FUNDA MAESTRA		FUNDA DE FIJACIÓN	ADAPTADOR DE FUNDA
	Utilizada para la perforación guiada y la inserción de implantes		Utilizada para soportar pin lateral	Se utiliza para adaptar las fresas de diámetro pequeño a la funda grande (SLL)
CÓDIGO	SLS	SLL	SLSE	SLSA
REF. NO.	66012	66013	66014	65058
INSTRUC-CIONES	Para implantes Ø 3.2, Ø 3.3, Ø 3.5, Ø 3.7N y Ø 3.75. 5 unidades en cada paquete.	Para implantes Ø 4.2, Ø 4.65, Ø 5 y Ø 5.3. 5 unidades en cada paquete.	Para fresa de 1,5 mm y pin lateral. 5 unidades en cada paquete.	Debe retirarse antes de la inserción del implante. Vea la nota* debajo

OBSERVACIÓN: La colocación del implante a través de la guía es compatible sólo con implantes NeO y ATID.

INFORMACIÓN DE PEDIDO:

El kit está disponible en tres configuraciones diferentes:

OPCIÓN BÁSICA	REF. NO. 65002	Kit completo de cirugía guiada para Conexión Standard Cónica (CS) y Conexión Hexagonal Cónica (CHC).
EXTENSIÓN BÁSICA	REF. NO. 65003	Kit completo de cirugía guiada para Hexágono Interno (IH), Conexión Standard Cónica (CS) y Conexión Hexagonal Cónica (CHC).
KIT COMPLETO	REF. NO. 65000	Kit completo de cirugía guiada para Hexágono interno (IH) y Conexión Hexagonal Cónica (CHC).

KIT DE TOPES

- Diseño compacto, ergonómico y estético.
- Organizado adecuadamente, todas las partes son claramente visibles y de fácil acceso.
- Marcas láser tanto en caja como en topes.
- Fácil limpieza y autoclavable.
- Surcos específicos para la extracción de topes.
- Los topes evitan el calentamiento del hueso durante la preparación de la osteotomía.
- Materiales: Caja - Radel®, Cubierta - PPHT.
- Dimensión: 13 cm x 9,5 cm x 3 cm.

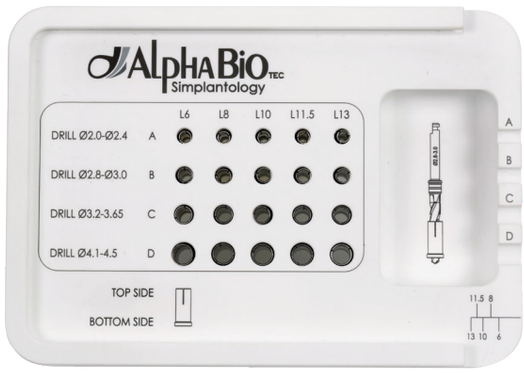

El kit está provisto de 20 topes

INFORMACIÓN DE PEDIDO: REF. NO. 4612

TOPES PARA FRESAS

FRESA DIÁMETRO	GRUPO A: Ø 2.0 - Ø 2.4				
FRESA PROFUNDIDAD	L6	L8	L10	L11.5	L13
REF. NO.	4561	4562	4563	4564	4565

FRESA DIÁMETRO	GRUPO B: Ø 2.8 - Ø 3.0				
FRESA PROFUNDIDAD	L6	L8	L10	L11.5	L13
REF. NO.	4566	4567	4568	4569	4570

FRESA DIÁMETRO	GRUPO C: Ø 3.2 - Ø 3.65				
FRESA PROFUNDIDAD	L6	L8	L10	L11.5	L13
REF. NO.	4573	4574	4575	4576	4577

FRESA DIÁMETRO	GRUPO D: Ø 4.1 - Ø 4.5				
FRESA PROFUNDIDAD	L6	L8	L10	L11.5	L13
REF. NO.	4578	4579	4580	4581	4582

LINEA DE **FRESAS REVESTIDAS**

- Una línea de fresado completa y fácil de usar.
- Codificada por colores.
- Alto contraste y marcas claras de profundidad.
- Revestimiento gris oscuro multicapa.
- Larga vida útil y alta resistencia a la corrosión.
- El diseño personalizado permite un bajo nivel de calentamiento y brinda máxima estabilidad.
- Compatible con todos los topes de fresas.

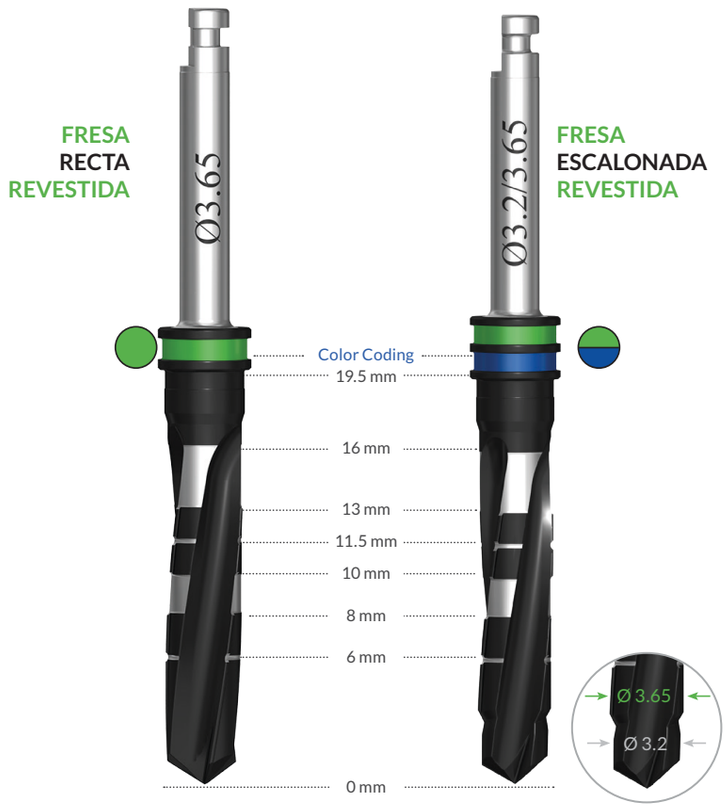

FRESAS RECTAS REVESTIDAS

	Ø 2.0	Ø 2.4	Ø 2.8	Ø 3.0	Ø 3.2	Ø 3.65	Ø 4.1	Ø 4.5	Ø 4.8	Ø 5.2	Ø 5.8
Code	BD2.0	BD2.4	BD2.8	BD3.0	BD3.2	BD3.65	BD4.1	BD4.5	BD4.8	BD5.2	BD5.8
Ref. No.	4550	4551	4552	4553	4554	4555	4556	4557	4558	4559	4560

FRESAS ESCALONADAS REVESTIDAS

	Ø 2.0/2.4	Ø 2.4/2.8	Ø 2.8/3.0	Ø 2.8/3.2	Ø 3.2/3.65	Ø 3.65/4.1	Ø 4.1/4.5	Ø 4.5/4.8	Ø 4.8/5.2
Code	BSD2.0-2.4	BSD2.4-2.8	BSD2.8-3.0	BSD2.8-3.2	BSD3.2-3.65	BSD3.65-4.1	BSD4.1-4.5	BSD4.5-4.8	BSD4.8-5.2
Ref. No.	4590	4592	4593	4594	4595	4596	4597	4598	4599

FRESAS QUIRÚRGICAS Y TRÉPANOS

FRESA AVELLANADORA (ACERO INOXIDABLE)



DIÁMETRO	2.7-5.9 mm
CÓDIGO	CS
REF. NO.	4672
INSTRUCCIONES	Para la preparación de un bisel dentro de la placa cortical de la cresta alveolar.

EXTENSIÓN DE LA FRESA (ACERO INOXIDABLE)

DIÁMETRO	Para todas las fresas
CÓDIGO	DX
REF. NO.	4240
INSTRUCCIONES	Extiende las fresas en 17,5 mm

FRESA DE MARCADO (ACERO INOXIDABLE)

DIÁMETRO	1.5 mm
CÓDIGO	MRDX1.5
REF. NO.	4712C
INSTRUCCIONES	Para marcar el centro de la placa cortical de la cresta alveolar

FRESA REDONDA (ACERO INOXIDABLE)

DIÁMETRO	2.3 mm	3 mm	4 mm
CÓDIGO	RB2.3	RB3	RB4
REF. NO.	4303	4304	4305
INSTRUCCIONES	Para diversas manipulaciones óseas, como la penetración de la placa cortical en la cresta alveolar		

FRESAS TRÉPANO (ACERO INOXIDABLE)

DIÁMETRO	4 mm	5 mm
CÓDIGO	DRT4	DRT5
REF. NO.	4940	4950
INSTRUCCIONES	Para extracción de hueso e implantes.	

HERRAMIENTAS **PARA LA INSERCIÓN DE IMPLANTES**

Conexión Standard Cónica

DESTORNILLADOR MANUAL 2.5 MM

LONGITUD	12 mm
CÓDIGO	MITD2.5-CS
REF. NO.	3806
INSTRUCCIONES	Para uso manual

DESTORNILLADOR DE INSERCIÓN 2.5 MM

LONGITUD	16 mm	10 mm
CÓDIGO	ITD2.5 L CS	ITD2.5 S CS
REF. NO.	3803	3801
INSTRUCCIONES	Compatible con llave hexagonal de 6.35 mm o llave criquet cuadrada de 4 mm	

CONTRA ÁNGULO 2.5 MM

LONGITUD	23 mm	16 mm
CÓDIGO	IT2.5 LM CS	IT2.5 SM CS
REF. NO.	3805	3804
INSTRUCCIONES	Para ser usado con un motor de contra ángulo	

Conexión Hexagonal Cónica

DESTORNILLADOR MANUAL 2.1 MM

LONGITUD	12 mm
CÓDIGO	MITD2.1-CHC
REF. NO.	4147
INSTRUCCIONES	Para uso manual

DESTORNILLADOR DE INSERCIÓN 2.1 MM

LONGITUD	20 mm	15 mm	10 mm
CÓDIGO	ITD2.1L-CHC	ITD2.1-CHC	ITD2.1S-CHC
REF. NO.	7301	7305	7302
INSTRUCCIONES	Compatible con llave hexagonal de 6.35 mm o llave criquet cuadrada de 4 mm		

CONTRA ÁNGULO 2.1 MM

LONGITUD	23 mm	16 mm
CÓDIGO	IT2.1L M-CHC	IT2.1S M-CHC
REF. NO.	7303	7304
INSTRUCCIONES	Para ser usado con un motor de contra ángulo	

HERRAMIENTAS PARA LA INSERCIÓN DE IMPLANTES

Conexión Hexagonal Interna

DESTORNILLADOR MANUAL 2.5 MM

LONGITUD	12 mm
CÓDIGO	MITD2.5-IH
REF. NO.	4146
INSTRUCCIONES	Para uso manual

DESTORNILLADOR DE INSERCIÓN 2.5 MM

LONGITUD	16 mm	10 mm	6 mm
CÓDIGO	G-ITDL2.5	G-ITDM2.5	G-ITDS2.5
REF. NO.	4140	4141	4142
INSTRUCCIONES	Compatible con llave hexagonal de 6.35 mm o llave criquet cuadrada de 4 mm o destornillador quirúrgico.		

CONTRA ÁNGULO 2.5/1.25 M

LONGITUD	23 mm	16 mm
CÓDIGO	GITL2.5/1.25	GITS2.5/1.25
REF. NO.	4143	4145
INSTRUCCIONES	Para ser usado con un motor de contra ángulo	

DESTORNILLADOR DE INSERCIÓN* (ACERO INOXIDABLE)

TIPO	Manual	2.5 mm largo	2.5 mm	2.5 mm largo
CÓDIGO	HTW	ITD 2.5	ITD 2.5 S	ITD 2.5 SS
REF. NO.	4014	4151	4152	4153
INSTRUCCIONES	Compatible con destornilladores de cabeza hexagonal de 6.35 mm.	Compatible con llave hexagonal de 6.35 mm o llave de torque cuadrada de 4 mm o destornillador quirúrgico.		

DESTORNILLADOR CONTRA ÁNGULO* (ACERO INOXIDABLE)

TIPO	Montaje mecánico 2.5/1.25 mm	Montaje mecánico corto 2.5/1.25 mm	Montaje mecánico 2.5 mm	Montaje mecánico corto 2.5 mm
CÓDIGO	IT 2.5M+	ITS 2.5/1.25	IT 2.5	ITS 2.5
REF. NO.	4161	4071	4073	4072
INSTRUCCIONES	Se utiliza para la inserción de implantes o para ajustar los tornillos de cobertura, los pilares de cicatrización y los tornillos de 1,25 mm.		Se utiliza para la inserción de implantes (2,5 mm).	

* Compatible solo con los paquetes Spiral, DFI e ICE.

HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN DE PRÓTESIS

DESTORNILLADORES HEXAGONALES 1.25 MM* (ACERO INOXIDABLE)

DESTORNILLADORES MANUALES

LONGITUD	13 mm	7 mm
CÓDIGO	HHS 1.25	HHSS 1.25
REF. NO.	4052	4053
INSTRUCCIONES	Para uso manual	

DESTORNILLADORES HEXAGONALES

LONGITUD	20 mm	14.5 mm	11.5 mm
CÓDIGO	HTD 1.25 L	HTD 1.25	HTD 1.25 S
REF. NO.	4061	4055	4056
INSTRUCCIONES	Compatible con llave hexagonal de 6.35 mm o llave de torque cuadrada de 4 mm o llave de torque.		

CONTRA ÁNGULO

LONGITUD	21 mm
CÓDIGO	HT 1.25M
REF. NO.	4165
INSTRUCCIONES	Para uso con una pieza para contra ángulo.

DESTORNILLADORES HEXAGONALES 1.5 MM** (ACERO INOXIDABLE)

DESTORNILLADORES HEXAGONALES MANUALES

LONGITUD	13 mm	7 mm
CÓDIGO	HHL 1. 5	HHS 1. 5
REF. NO.	4060	4059
INSTRUCCIONES	Para uso manual	

DESTORNILLADORES HEXAGONALES

LONGITUD	14.5 mm	7 mm
CÓDIGO	HTD 1.5	HTD 1.5 S
REF. NO.	4057	4058
INSTRUCCIONES	Apto para llave hexagonal de 6.35 mm o llave críquet cuadrada de 4 mm o llave de torque	

CONTRA ÁNGULO

LONGITUD	21 mm
CÓDIGO	HT 1. 5
REF. NO.	4168
INSTRUCCIONES	Para ser usado con un motor de contra ángulo

* Compatible con todos los pilares de cicatrización, tornillos de cierre, tornillos de transferencia y la mayoría de los pilares.
** Sólo para uso con pilares rectos (TCT). Ver páginas 29, 43, 62.

ACCESORIOS QUIRÚRGICOS PARA TODOS LOS IMPLANTES

GUÍAS DE PROFUNDIDAD Y PARALELISMO (TITANIO)



LONGITUD	16 mm	10 mm
CÓDIGO	PDG	PDGS
REF. NO.	4080	4081
INSTRUCCIONES	Para la medición precisa de la profundidad de la osteotomía, la comprobación del paralelismo y la distorsión de rayos X. Cada paso es de 1 mm	

GUÍAS DE PARALELISMO (TITANIO)

CÓDIGO	PG
REF. NO.	4082
INSTRUCCIONES	Se utiliza para el espaciado preciso y la colocación de implantes paralelos.



SONDA DE PROFUNDIDAD DE IMPLANTE IDG (ACERO INOXIDABLE)

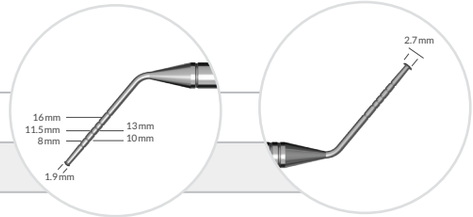

CÓDIGO	IDG
REF. NO.	4100
INSTRUCCIONES	Sonda de medición de dos caras: - El ancho de 1.9 mm del ápice redondeado se usa para examinar osteotomías realizadas con fresa de 2 mm. - El ancho de 2.7 mm del ápice redondeado se utiliza para examinar osteotomías realizadas con fresa de 2.8 mm. Puede utilizarse en diversos tratamientos, como: control de la profundidad de la osteotomía, examen de la membrana de Schneider, condensación ósea y otros.

DESTORNILLADOR QUIRÚRGICO

CÓDIGO	SDH
REF. NO.	4220
INSTRUCCIONES	Para un cabezal hexagonal de 6.35 mm

TORQUE UNIVERSAL/CARRACA 10-45 NCM (ACERO INOXIDABLE)

CÓDIGO	URT
REF. NO.	4572
INSTRUCCIONES	Permite a los profesionales aplicar con precisión el torque recomendado al usar prótesis o destornilladores quirúrgicos.

PLATAFORMAS DE IMPLANTE

El portafolio de Alpha-Bio Tec consiste en dos plataformas, Hexagonal Interna y Hexagonal Cónica. La plataforma Hexagonal Interna incluye todos los sistemas de implantes tradicionales reconocidos, que permiten una práctica sencilla y eficiente para el procedimiento de restauración, ya que todos los implantes se ajustan a la misma línea protésica. Los diferentes sistemas cubren diversos casos clínicos, desde los más simples hasta los más complicados.

Nuestra plataforma Hexagonal Cónica proporciona soluciones para crestas alveolares estrechas y espacios limitados, así como para casos que requieran alto nivel de estética. Es un diseño que preserva el tejido blando y mejora los resultados estéticos. Además, la conexión cónica mejora el ajuste implante-pilar.

PLATAFORMA HEXAGONAL **CÓNICA**

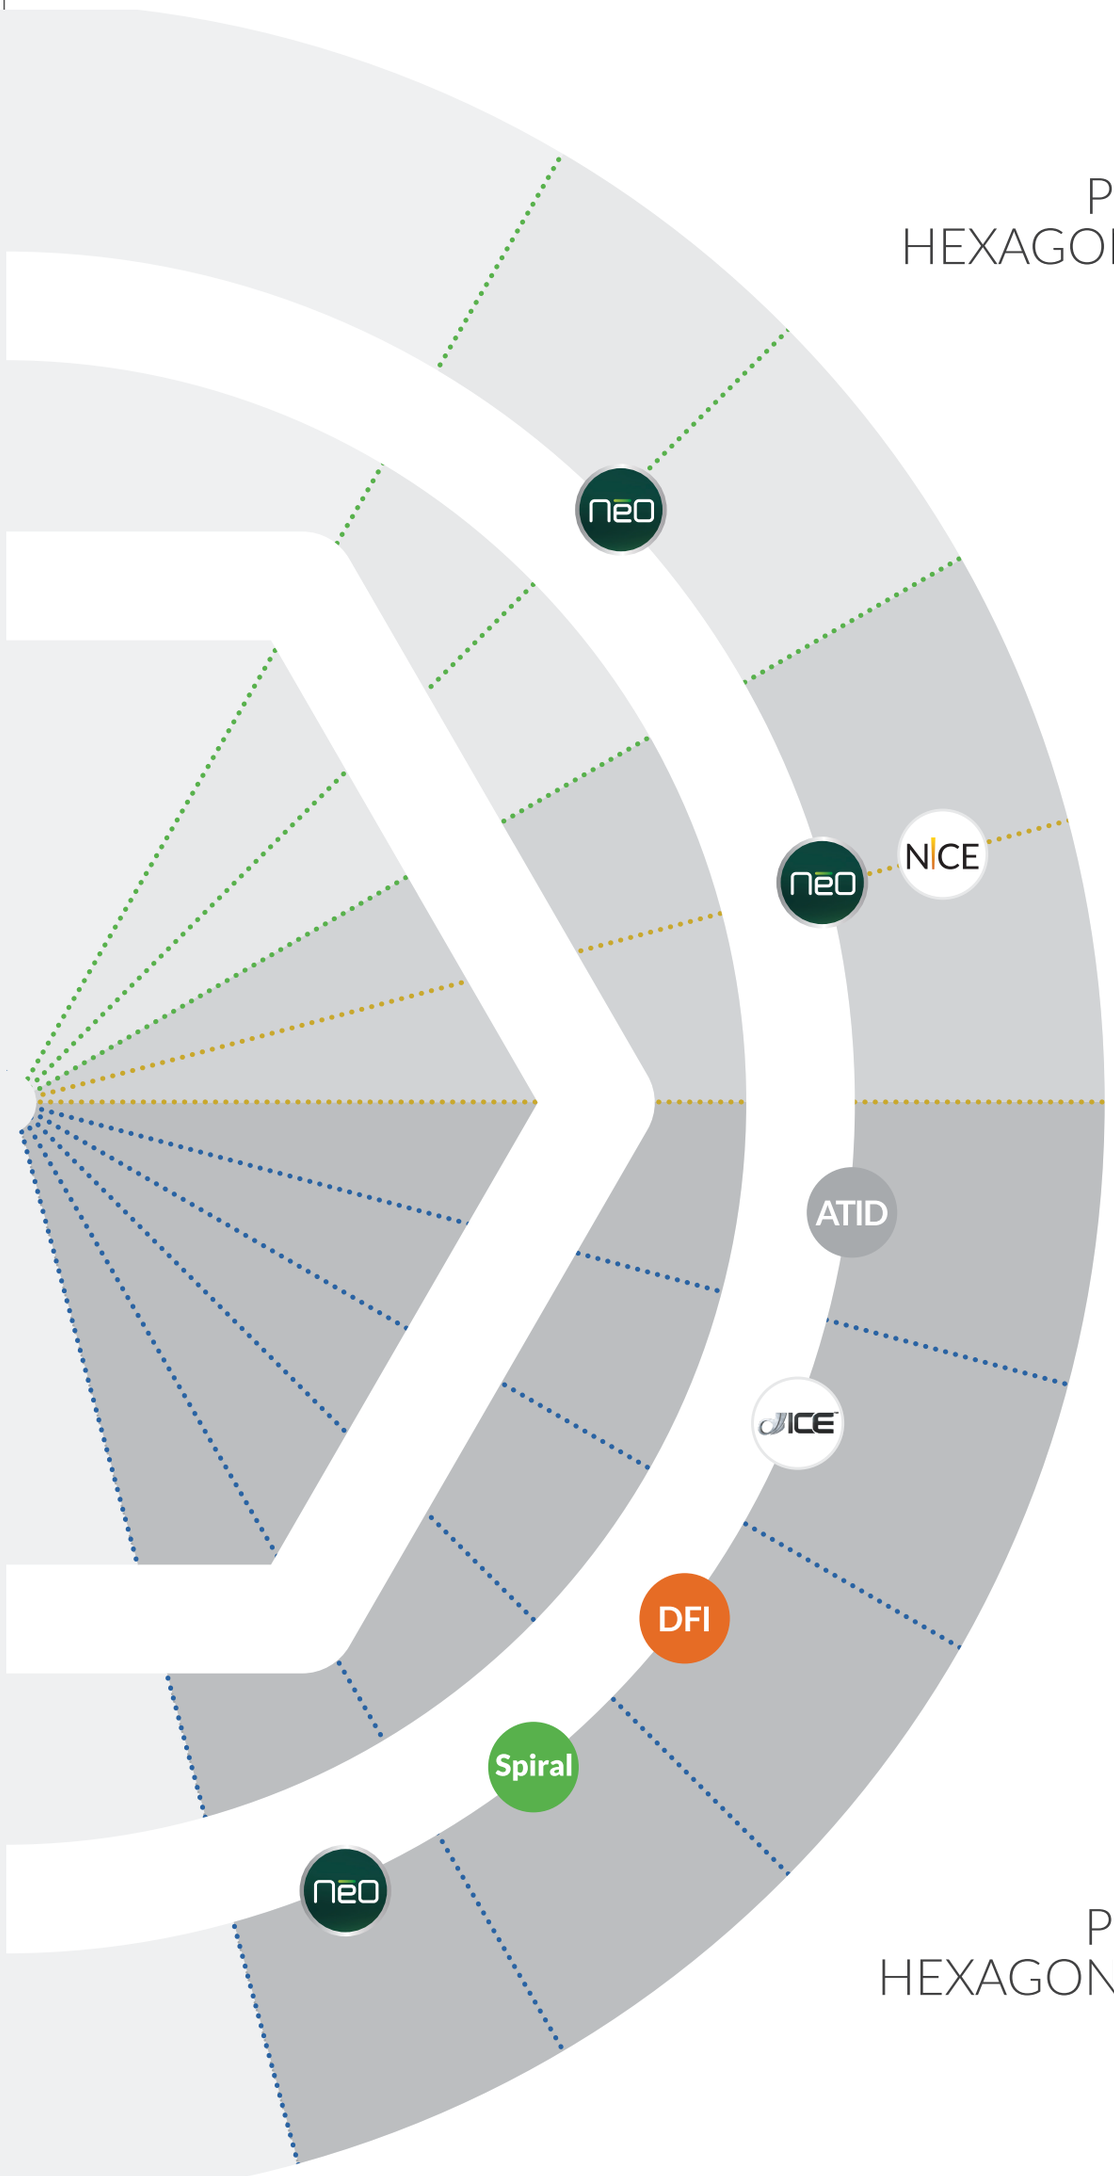

Conexión
Standard Cónica (CS)

Conexión
Hexagonal Cónica

Conexión
Hexagonal Interna

PLATAFORMA HEXAGONAL **INTERNA**

SISTEMA NEO LA NUEVA SENSACIÓN

Conexión
Standard Cónica (CS)

TIPOS DE HUESO	II, III, IV
CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE DISEÑO	• Cónico • Parte apical con características de centrado y anclaje • Dos micro espiras • Intercambio de plataforma
BENEFICIOS CLÍNICOS	• Óptima estabilidad primaria • Alta conservación ósea • Micro espiras que aumentan la superficie en un 20% • Aumento temprano del BIC

INFORMACIÓN DE PEDIDO

	Ø 3.75	Ø 4.2	Ø 5.0
8 mm	1138	1148	1158
10 mm	1130	1140	1150
11.5 mm	1131	1141	1151
13 mm	1133	1143	1153
16 mm	1136	1146	N/A

Importante: Pueden requerirse consideraciones profesionales para las adaptaciones del protocolo de fresado en casos específicos

SISTEMA NEO LA NUEVA SENSACIÓN

Conexión
Standard Cónica (CS)

PROTOCOLO DE FRESADO PARA FRESAS ESCALONADAS

Ø 3.75

Hueso Blando Tipo IV		Hueso Mediano Tipo II y III			Hueso Duro Tipo I			
Ø2.0	Ø2.4/Ø2.8	Ø2.0	Ø2.4/Ø2.8	Ø2.8/Ø3.2	Ø2.0	Ø2.4/Ø2.8	Ø2.8/Ø3.2	Ø3.2/Ø3.65 Cortical*



Ø 4.2

Hueso Blando Tipo IV			Hueso Mediano Tipo II y III			Hueso Duro Tipo I			
Ø2.0	Ø2.4/Ø2.8	Ø2.8/Ø3.2	Ø2.0	Ø2.4/Ø2.8	Ø3.2/Ø3.65	Ø2.0	Ø2.4/Ø2.8	Ø3.2/Ø3.65	Ø3.65/Ø4.1 Cortical*

Ø 5.0

Hueso Blando Tipo IV			Hueso Mediano Tipo II y III				Hueso Duro Tipo I					
Ø2.0	Ø2.4 / Ø2.8	Ø3.2 / Ø3.65	Ø2.0	Ø2.4 / Ø2.8	Ø3.2 / Ø3.65	Ø3.65 / Ø4.1	Ø2.0	Ø2.4 / Ø2.8	Ø3.2 / Ø3.65	Ø3.65 / Ø4.1	Ø4.1 / Ø4.5	Ø4.5 / Ø4.8 Cortical*



*** Cortical - Fresar a través de la placa cortical con el diámetro más grande.**

PROTOCOLO DE FRESADO PARA FRESAS RECTAS

Ø 3.75

Hueso Blando Tipo IV			Hueso Mediano Tipo II y III			Hueso Duro Tipo I			
Ø2.0	Ø2.4	Ø2.8**	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2**	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2**	Ø3.65 Cortical*



Ø 4.2

Hueso Blando Tipo IV			Hueso Mediano Tipo II y III				Hueso Duro Tipo I				
Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2**	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65**	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65**	Ø4.1 Cortical*



Ø 5.0

Hueso Blando Tipo IV				Hueso Mediano Tipo II y III					Hueso Duro Tipo I						
Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65**	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65	Ø4.1**	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65	Ø4.1	Ø4.5**	Ø4.8 Cortical*

* Cortical – Fresar a través de la placa cortical

** 3mm más corto que la longitud del implante. Tenga en cuenta que la fresa puede ser sustituida por la fresa escalonada correspondiente en toda la longitud del implante. Para obtener más información, consulte protocolo de fresado escalonado.

HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN
Y PILARES DE CICATRIZACIÓN

Conexión
Standard Cónica (CS)

HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN DE IMPLANTES

DESTORNILLADOR MANUAL 2.5 MM

LONGITUD	12 mm
CÓDIGO	MITD2.5-CS
REF. NO.	3806
INSTRUCCIONES	For manual use

DESTORNILLADOR INSERCIÓN 2.5 MM

LONGITUD	15 mm	10 mm
CÓDIGO	ITD2.5 L CS	ITD2.5 S CS
REF. NO.	3803	3801
INSTRUCCIONES	Compatible con llave hexagonal de 6.35 mm o llave criquet cuadrada de 4 mm	

CONTRA ÁNGULO 2.5 MM

LONGITUD	23 mm	16 mm
CÓDIGO	IT2.5 LM CS	IT2.5 SM CS
REF. NO.	3805	3804
INSTRUCCIONES	Para ser usado con un motor de contra ángulo	

PILARES DE CICATRIZACIÓN*

Ø 4.0

DIMENSIONES	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
CÓDIGO	HA-D4-CH1.5-CS	HA-D4-CH2.5-CS	HA-D4-CH3.5-CS	HA-D4-CH4.5-CS	HA-D4-CH5.5-CS
REF. NO.	3401	3402	3403	3404	3405

Ø 4.9

DIMENSIONES	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
CÓDIGO	HA-D4.9-CH1.5-CS	HA-D4.9-CH2.5-CS	HA-D4.9-CH3.5-CS	HA-D4.9-CH4.5-CS	HA-D4.9-CH5.5-CS
REF. NO.	3407	3408	3409	3410	3411

Ø 6.2

DIMENSIONES	1.5 mm	2.5 mm
CÓDIGO	HA-D6.2-CH1.5-CS	HA-D6.2-CH2.5-CS
REF. NO.	3412	3413

* Torque de cierre recomendado: 10Ncm máx.

IMPRESIÓN Y MOLDEADO

Conexión
Standard Cónica (CS)

IMPRESIÓN

TRANSFER DE BANDEJA ABIERTA



DIÁMETRO	Ø 4.7	Ø 4.7
LONGITUD	15 mm	19 mm
CÓDIGO	CTT-CS	CTTS-CS
REF. NO.	3455	3456
INSTRUCCIONES	Usar con destornillador 1.25 Observación: Torque de cierre recomendado: 10Ncm máx.	

TRANSFER DE BANDEJA CERRADA

DIÁMETRO	Ø 4.7	Ø 4.7
LONGITUD	12 mm	15 mm
CÓDIGO	SCTT-CS	LCTT-CS
REF. NO.	3450	3451
INSTRUCCIONES	Usar con destornillador 1.25 Observación: Torque de cierre recomendado: 10Ncm máx.	

TRANSFER PLÁSTICO

CÓDIGO	HTLASP
REF. NO.	5364
INSTRUCCIONES	Para uso con los pilares 3501, 3502, 3503 y 3504.

ANÁLOGO



DIÁMETRO	Ø 3.75
CÓDIGO	IA-CS
REF. NO.	3459

MOLDEADO DE PILARES**



Los pilares CHC CoCr incluyen dos bases: Base de CoCr y Base de Titanio.
Retire la base de titanio antes de fundir



TEMPERATURA DE FUSIÓN DEL CoCr	>1290°C - 1380°C	>1290°C - 1380°C
CÓDIGO	CoCr-AR-CHCS	CoCr-R-CHCS
REF. NO.	3846	3847
INSTRUCCIONES	El diseño del producto incluye dos partes desmontables: 1. Base de titanio 2. Funda de plástico con base de CoCr. Por favor, consulte las instrucciones de uso (IFU) del producto para obtener más información.	

** Torque de cierre recomendado: 30Ncm.

RESTAURACIÓN CEMENTADA

Conexión
Standard Cónica (CS)

PILARES ESTÉTICOS*

RECTO Ø 4.8

DIMENSIONES	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm
CÓDIGO	TLA-H1.5-CS	TLA-H2.5-CS	TLA-H3.5-CS	TLA-H4.5-CS
REF. NO.	3501	3502	3503	3504
INSTRUCCIONES	Torque de cierre recomendado: 30 Ncm.			

PILARES ANGULADOS*

15°

DIMENSIONES	1.5 mm	2.5 mm
CÓDIGO	TLA-15-H1.5-CS	TLA-15-H2.5-CS
REF. NO.	3511	3512
INSTRUCCIONES	Torque de cierre recomendado: 30 Ncm.	

25°

DIMENSIONES	1.5 mm	2.5 mm
CÓDIGO	TLA-25-H1.5-CS	TLA-25-H2.5-CS
REF. NO.	3514	3515
INSTRUCCIONES	Torque de cierre recomendado: 30 Ncm.	

PILARES TEMPORARIOS

DIMENSIONES	1.5 mm	1.5 mm
CÓDIGO	TA-AR-CS (anti-rotacional) ⬡	TA-R-CS (rotacional) ◯
REF. NO.	3532	3533
INSTRUCCIONES	Utilice un destornillador de 1,25 mm con un torque de 30 Ncm.	

TORNILLO*

USO	Para clínica	Para recuperación
CÓDIGO	STLA-CS	RS
REF. NO.	3510	5110**
INSTRUCCIONES	Tornillo de pilar CS (incluido en el paquete)	

* Torque de cierre recomendado: 30Ncm.

** Se adapta a las plataformas IH y CS.

RESTAURACIÓN ATORNILLADA

ALPHA UNIVERSE MULTI UNIT ABUTMENTS

PILARES ANGULADOS MULTI UNITS

17°

DIMENSIONES	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm
CÓDIGO	AU 17-1.5-CS	AU 17-2.5-CS	AU 17-3.5-CS
REF. NO.	3862	3863	3864
INSTRUCCIONES	Utilice un destornillador de 1,25 mm con un torque de 30 Ncm.		

30°

DIMENSIONES	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm
CÓDIGO	AU 30-1.5-CS	AU 30-2.5-CS	AU 30-3.5-CS
REF. NO.	3867	3868	3869
INSTRUCCIONES	Utilice un destornillador de 1,25 mm con un torque de 30 Ncm.		

PILARES RECTOS MULTI UNITS PARA RESTAURAR UN DESVÍO DE HASTA 30° ENTRE LAS PIEZAS DENTALES

DIMENSIONES	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm
CÓDIGO	TCT-0.5-CS	TCT-1.5-CS	TCT-2.5-CS
REF. NO.	3870	3871	3872
INSTRUCCIONES	Utilice un destornillador de 1,5 mm para la inserción (consulte la página 20). Torque de cierre recomendado: 30 Ncm*. La estructura superior de los pilares sigue siendo la misma y se puede utilizar con productos Alpha Universe, a excepción de los productos AR. Para el proceso de restauración digital, utilice el body scan rotacional 3883.		

* No se recomienda para restauraciones de una sola pieza dental.

PILARES RECTOS - PARA RESTAURACIÓN DE IMPLANTES ÚNICOS

DIMENSIONES	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm
CÓDIGO	HBC-H0.5-CS	HBC-H1.5-CS	HBC-H2.5-CS
REF. NO.	3876	3877	3878
INSTRUCCIONES	Utilice un destornillador de 1,25 mm con un torque de 30 Ncm. Los pilares se suministran con un tornillo y una funda plástica calcinable.		

PILARES DE CICATRIZACIÓN*

DIMENSIONES	4 mm	6 mm
CÓDIGO	HCT4-N	HCT6-N
REF. NO.	5236	5237
INSTRUCCIONES	Provisto de un tornillo integral. Torque de cierre recomendado 10 Ncm.	

TRANSFERS Y ANÁLOGO





TIPO	Transfer de bandeja abierta	
CÓDIGO	TST-N	TCT-N-R
REF. NO.	5231 (anti-rotacional) △	5248 (rotacional) ◯
INSTRUCCIONES	Provisto de tornillo 6012. Se recomienda cerrar manualmente.	

TIPO	Transfer en bandeja cerrada
CÓDIGO	TS-N
REF. NO.	5235
INSTRUCCIONES	Se recomienda cerrar manualmente

TIPO	Análogo
MATERIAL	Titanio
CÓDIGO	BTT-N
REF. NO.	5211

RESTAURACIÓN DE SOBREDENTADURAS

Conexión
Standard Cónica (CS)

PILAR TEMPORARIO



MATERIAL	Titanio
CÓDIGO	TTA-N
REF. NO.	5216
INSTRUCCIONES	Torque de cierre recomendado: 25 Ncm. Provisto de tornillo 6092.

CALCINABLES

MATERIAL	Plastic	Plastic
CÓDIGO	PST-N-AR	PST-N
REF. NO.	5217 (anti-rotacional) △	5218 (rotacional) ◯
INSTRUCCIONES	Se recomienda cerrar sólo manualmente (sin herramienta). Provisto de tornillo 6093.	

TORNILLO DE FIJACIÓN

MATERIAL	Titanio	Titanio revestido negro
CÓDIGO	SF-N	SFT-N
REF. NO.	6092	6093
INSTRUCCIONES	Utilice HTD 1,25 mm para la inserción. El tornillo 6093 es sólo para uso en laboratorio.	

RESTAURACIÓN DE SOBREDENTADURAS

Conexión
Standard Cónica (CS)

SISTEMA DE PILARES ALPHALOC

PILARES RECTOS (ALEACIÓN DE TITANIO CON RECUBRIMIENTO DE ESTAÑO (TiN)

DIMENSIONES	0.75 mm	2 mm	3 mm	4 mm
REF. DEL KIT NO.	3710	3711	3712	3713
INSTRUCCIONES	Torque de cierre recomendado: 30 Ncm. El kit incluye: 1 retenedor de la altura indicada, 1 estructura metálica de acero inoxidable, 4 cofias de retención, 1 anillo espaciador, 1 cofia de laboratorio.			

PAQUETE DE REPUESTO

INCLUYE	Estructura de metal de acero inoxidable, anillo espaciador, machos de reemplazo de nylon (violeta, transparente, rosa y amarillo) cofia de laboratorio (negro)
REF. NO.	4875

COFIAS MACHO DE REPUESTO

COLOR	Violeta (retención fuerte)	Transparente (retención estándar)	Rosa (retención suave)	Amarillo (Retención extra suave)
REF. NO.	4876	4877	4878	4879
INCLUYE	4 unidades en cada kit			

RESTAURACIÓN DE SOBREDENTADURAS

Conexión
Standard Cónica (CS)

ACCESORIOS ALPHALOC

ANÁLOGO HEMBRA

CONTENIDO	4 unidades
REF. NO.	4885

HERRAMIENTA DE INSERCIÓN

CONTENIDO	1 unidad
REF. NO.	4886

HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN

CONTENIDO	1 unidad
REF. NO.	4887

COFIA PARA LABORATORIO (NEGRA)

COLOR	Negra
CONTENIDO	4 unidades
REF. NO.	4882

ANILLO ESPACIADOR

CONTENIDO	1 unidad
REF. NO.	4883

COFIA PARA IMPRESIÓN

CONTENIDO	1 unidad
REF. NO.	4884

PARTES PARA RESTAURACIÓN CAD/CAM

Conexión Standard Cónica (CS)

RESTAURACIÓN A NIVEL DE IMPLANTE

BODY SCAN DE DOBLE USO

ALTURA	10 mm
CÓDIGO	IOSB-CS
REF. NO.	3837
INSTRUCCIONES	Para laboratorio y uso intraoral. Máx. 10 Ncm.

BASES-TI RECTAS (ANTI-ROTACIONAL)

ALTURA	0.75 mm / 4.87 mm	1.5 mm / 5.62 mm	2.5 mm / 6.62 mm
CÓDIGO	TB-0.75-AR-CS	TB-1.5-AR-CS	TB-2.5-AR-CS
REF. NO.	3832	3840	3842
INSTRUCCIONES	Para restauraciones de una sola pieza dental. Torque de cierre recomendado: 30 Ncm.		

BASES-TI RECTAS (ROTACIONAL)

ALTURA	0.75 mm / 4.87 mm	1.5 mm / 5.62 mm	2.5 mm / 6.62 mm
CÓDIGO	TB-0.75-R-CS	TB-1.5-R-CS	TB-2.5-R-CS
REF. NO.	3833	3841	3843
INSTRUCCIONES	Para restauración de barras/puentes. Torque de cierre recomendado: 30 Ncm.		

BLOQUES PRE-FRESADOS (TORNILLO INCLUIDO)

DIÁMETRO	Ø 11.5	Ø 15.8
CÓDIGO	BA_PF_CS	WBA_PF_CS
REF. NO.	3854	3855
INSTRUCCIONES	Para el soporte de pilar PreFace®. Torque de cierre recomendado: 30 Ncm.	

ANÁLOGO

CÓDIGO	AN-PM-CS
REF. NO.	3838
IINSTRUCCIONES	Para modelos impresos

PARTES PARA RESTAURACIÓN CAD/CAM

Conexión Standard Cónica (CS)

RESTAURACIÓN A NIVEL DEL PILAR

BODY SCAN DE DOBLE USO

ALTURA	7 mm	7 mm
CÓDIGO	IOSB-TCT-N-R	IOSB-TCT-N
REF. NO.	3883 (rotacional)	5003 (anti-rotacional)
INSTRUCCIONES	Para la restauración de puentes con pilares rectos y angulados de MultiUnit. Máx. 10 Ncm.	Para restauraciones de una sola corona con pilares angulados MultiUnit. Utilice el destornillador estándar (4052). Máx. 10 Ncm.

COPING ADHESIVO

ALTURA	3.5 mm	3.5 mm
CÓDIGO	TAC-TCT-N	TAC-TCT-N-R
REF. NO.	5028 (anti-rotacional) ⬡	5029 (rotacional) ◯
INSTRUCCIONES	Para restauraciones de una sola pieza dental	Para la restauración de barras/puentes

TORNILLO PARA MONTAJE DIRECTO*

CÓDIGO	S-DM-SR
REF. NO.	4994
INSTRUCCIONES	Para montaje directo sobre bastidor metálico.

* No debe utilizarse para restauraciones completas de óxido de circonio o cerámica.

ANÁLOGO PARA TCT-N

CÓDIGO	BTT-N
REF. NO.	5211
INSTRUCCIONES	Adecuado para TCT-N y TCT-N-R. También para modelo impreso.

COMPATIBLE CON SIRONA

TI-BASE RECTO

CÓDIGO	CSTB-CS-SI
REF. NO.	3856
INSTRUCCIONES	Para uso en escaneado y/o restauración. Torque de cierre recomendado: 30 Ncm.

SCAN POST

CÓDIGO	CSSP-CS-SI
REF. NO.	3857
INSTRUCCIONES	Sólo para propósitos de escaneo. Torque de cierre recomendado: 30 Ncm.

Para más información sobre las bibliotecas, visite **www.alpha-bio.net**.

SISTEMA NEO LA NUEVA SENSACIÓN

Conexión Hexagonal Cónica (CHC)

TIPOS DE HUESO	II, III, IV
CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE DISEÑO	• Cónico • Parte apical con características de centrado y anclaje • Dos micro espiras • Intercambio de plataforma
BENEFICIOS CLÍNICOS	• Óptima estabilidad primaria • Alta conservación ósea • Micro espiras que aumentan la superficie en un 20% • Aumento temprano del BIC

INFORMACIÓN DE PEDIDO



	Ø 3.2	Ø 3.5
8 mm	1108	1128
10 mm	1100	1120
11.5 mm	1101	1121
13 mm	1103	1123
16 mm	1106	1126

Importante: Pueden requerirse consideraciones profesionales para las adaptaciones del protocolo de fresado en casos específicos.

PROTOCOLO DE FRESADO PARA FRESAS ESCALONADAS

Ø 3.2

Hueso Blando Tipo IV	Hueso Mediano Tipo II y III		Hueso Duro Tipo I		
Ø2.0	Ø2.0	Ø2.4/Ø2.8	Ø2.0	Ø2.4/Ø2.8	Ø2.8/Ø3.0

Ø 3.5

Hueso Blando Tipo IV		Hueso Mediano Tipo II y III			Hueso Duro Tipo I		
Ø2.0	Ø2.0/Ø2.4	Ø2.0	Ø2.4/Ø2.8	Ø2.8/Ø3.0	Ø2.0	Ø2.4/Ø2.8	Ø2.8/Ø3.2

PROTOCOLO DE FRESADO PARA FRESAS RECTAS

Ø 3.2

Hueso Blando Tipo IV	Hueso Mediano Tipo II y III			Hueso Duro Tipo I		
Ø2.0	Ø2.0	Ø2.4	Ø2.8*	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.0*

Ø 3.5

Hueso Blando Tipo IV		Hueso Mediano Tipo II y III			Hueso Duro Tipo I		
Ø2.0	Ø2.4*	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.0*	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2*

* 3 mm más corto que la longitud del implante.

SISTEMA NICE UNA SOLUCIÓN AMPLIA PARA CRESTAS ANGOSTAS

Conexión Hexagonal Cónica (CHC)

NICE

TIPOS DE HUESO	I, II, III, IV
CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE DISEÑO	• Moderadamente cónico • Conicidad invertida • Micro espiras coronales divididas
BENEFICIOS CLÍNICOS	• Mejor distribución del estrés • Soporta una amplia gama de casos clínicos • Penetración ósea controlada

INFORMACIÓN DE PEDIDO



	Ø 3.2
8 mm	1068
10 mm	1060
11.5 mm	1061
13 mm	1063
16 mm	1066

Importante: Pueden requerirse consideraciones profesionales para las adaptaciones del protocolo de fresado en casos específicos.

PROTOCOLO DE FRESADO PARA FRESAS RECTAS

Ø 3.2

Hueso Blando Tipo IV	Hueso Mediano Tipo II y III			Hueso Duro Tipo I		
Ø2.0 ○	Ø2.0 ○	Ø2.8 ●	*	Ø2.0 ○	Ø2.8 ●	Ø3.0** ●



* En los casos de capa cortical gruesa, use una fresa de 3.0 mm solo a través de la corteza.

** 3 mm más corto que la longitud del implante.

HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN Y PILARES DE CICATRIZACIÓN

Conexión Hexagonal Cónica (CHC)

HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN DE IMPLANTES

DESTORNILLADOR MANUAL 2.1 MM

LONGITUD	12 mm
CÓDIGO	MITD2.1-CHC
REF. NO.	4147
INSTRUCCIONES	Para uso manual

DESTORNILLADOR DE INSERCIÓN 2.1 MM

LONGITUD	20 mm	15 mm	10 mm
CÓDIGO	ITD2.1L-CHC	ITD2.1-CHC	ITD2.1S-CHC
REF. NO.	7301	7305	7302
INSTRUCCIONES	Compatible con llave hexagonal de 6.35 mm o llave criquet cuadrada de 4 mm		

CONTRA ÁNGULO 2.1 MM

LONGITUD	23 mm	16 mm
CÓDIGO	IT2.1L M-CHC	IT2.1S M-CHC
REF. NO.	7303	7304
INSTRUCCIONES	Para ser usado con un motor de contra ángulo	

PILARES DE CICATRIZACIÓN*

Ø 3.4

ALTURA	2 mm	3 mm	5 mm
CÓDIGO	HSD3.4-2-CHC	HSD3.4-3-CHC	HSD3.4-5-CHC
REF. NO.	7311	7312	7313

Ø 3.8

ALTURA	2 mm	3 mm	5 mm
CÓDIGO	HSD3.8-2-CHC	HSD3.8-3-CHC	HSD3.8-5-CHC
REF. NO.	7315	7316	7317

Ø 4.2

ALTURA	2 mm	3 mm	5 mm
CÓDIGO	HSD4.2-2-CHC	HSD4.2-3-CHC	HSD4.2-5-CHC
REF. NO.	7319	7320	7321

*Torque de cierre recomendado: Máx. 10Ncm.

IMPRESIÓN Y MOLDEADO

Conexión Hexagonal Cónica (CHC)

IMPRESIÓN



TRANSFER DE BANDEJA ABIERTA



CÓDIGO	HLTO-CHC
REF. NO.	7335
INSTRUCTIONS	Se suministra con el tornillo LGP-CHC. Máx. 10 Ncm.

TRANSFER DE BANDEJA CERRADA

CÓDIGO	HLTS-CHC
REF. NO.	7333
INSTRUCCIONES	Se suministra con el tornillo LGP-CHC. Máx. 10 Ncm.

ANÁLOGO DEL IMPLANTE

CÓDIGO	IA-CHC
REF. NO.	7338

MOLDEADO DE PILARES**

Nuevo Diseño

Ø 3.6

Los pilares CHC CoCr incluyen dos bases: Base de CoCr y Base de Titanio.
Retire la base de titanio antes de fundir.

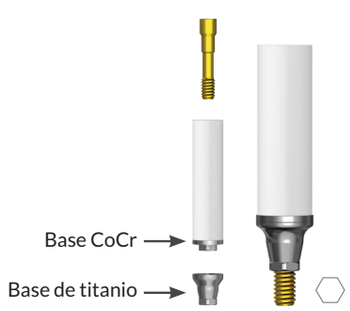



TEMPERATURA DE FUSIÓN CoCr	>1290°C - 1380°C	>1290°C - 1380°C
CÓDIGO	TLABCC-CHC	TLABCC-R-CHC
REF. NO.	3613	3614
INSTRUCCIONES	El diseño del producto incluye dos partes desmontables: 1. Base de titanio 2. Funda de plástico con base de CoCr. Por favor, consulte las instrucciones de uso (IFU) del producto para obtener más información.	

** Torque de cierre recomendado: 20Ncm.

RESTAURACIÓN CEMENTADA

Conexión Hexagonal Cónica (CHC)

PILARES ESTÉTICOS

RECTO Ø 3.6

ALTURA	1 mm / 8.9 mm	2 mm / 9.9 mm	3 mm / 10.9 mm	4 mm / 11.9 mm
CÓDIGO	ETLASP1-CHC	ETLAPS2-CHC	ETLAPS3-CHC	ETLAPS4-CHC
REF. NO.	7350	7351	7352	7353
INSTRUCCIONES	Torque de cierre recomendado: 20 Ncm. NO sobrepasar 20 Ncm.			

ANCHO Ø 4.0

ALTURA	1 mm / 11 mm	2 mm / 12 mm	3 mm / 13 mm	4 mm / 14 mm	5 mm / 15 mm
CÓDIGO	ETWASP1-CHC	ETWASP2-CHC	ETWASP3-CHC	ETWASP4-CHC	ETWASP5-CHC
REF. NO.	7370	7371	7372	7373	7374
INSTRUCCIONES	Torque de cierre recomendado: 20 Ncm. NO sobrepasar 20 Ncm.				

ESTÁNDAR (DIFERENTES DIÁMETROS)

MEDIDAS	Ø 3.2 / 9 mm	Ø 3.6 / 9 mm	Ø 4.0 / 11 mm
CÓDIGO	ETLAS3.2-CHC	ETLAS3.6-CHC	ETLAS4.0-CHC
REF. NO.	7356	7357	7383
INSTRUCCIONES	Torque de cierre recomendado: 20 Ncm. NO sobrepasar 20 Ncm.		

ESTÁNDAR Ø 4.0 / 9.2 MM

CÓDIGO	TLAS4.0-CHC
REF. NO.	7358

PILARES ANGULADOS

15°

ALTURA	1.1 mm / 8.2 mm	1.1 mm / 10.2 mm
CÓDIGO	ETLA15-CHC	ETLAL15-CHC
REF. NO.	7360	7361
INSTRUCCIONES	Torque de cierre recomendado: 20 Ncm. NO sobrepasar 20 Ncm.	

25°

ALTURA	1.1 mm / 8.2 mm
CÓDIGO	ETLA25-CHC
REF. NO.	7362
INSTRUCCIONES	Torque de cierre recomendado: 20 Ncm. NO sobrepasar 20 Ncm.

RESTAURACIÓN CEMENTADA

Conexión Hexagonal Cónica (CHC)

PILARES ANGULADOS ANATÓMICOS

15°

ALTURA	2.5 mm / 8.2 mm	3.5 mm / 10.2 mm	4.5 mm / 8.2 mm
CÓDIGO	EA15-1.5-CHC	EA15-2.5-CHC	EA15-3.5-CHC
REF. NO.	7363	7364	7365
INSTRUCCIONES	Torque de cierre recomendado: 20 Ncm. NO sobrepasar 20 Ncm.		

25°

ALTURA	2.5 mm / 9.5 mm	3.5 mm / 10.5 mm	4.5 mm / 11.5 mm
CÓDIGO	EA25-1.5-CHC	EA25-2.5-CHC	EA25-3.5-CHC
REF. NO.	7366	7367	7368
INSTRUCCIONES	Torque de cierre recomendado: 20 Ncm. NO sobrepasar 20 Ncm.		

TORNILLOS

TIPO	TORNILLO DEL PILAR
CÓDIGO	STLA-CHC
REF. NO.	7345

TIPO	TORNILLO DE RECUPERACIÓN
CÓDIGO	RS-CHC
REF. NO.	7400

PILARES ANGULADOS MULTIUNIT

17°

DIMENSIONES	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm
CÓDIGO	AU 17-1.5-CHC	AU 17-2.5-CHC	AU 17-3.5-CHC
REF. NO.	7482	7483	7484
INSTRUCCIONES	Utilice un destornillador de 1,25 mm. Utilice 20 Ncm para ajustar el tornillo del pilar (consulte la página 20).		

30°

DIMENSIONES	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm
CÓDIGO	AU 30-1.5-CHC	AU 30-2.5-CHC	AU 30-3.5-CHC
REF. NO.	7487	7488	7489
INSTRUCCIONES	Utilice un destornillador de 1,25 mm. Utilice 20 Ncm para ajustar el tornillo del pilar (consulte la página 20).		

PILARES DE CICATRIZACIÓN

DIMENSIONES	4 mm	6 mm
CÓDIGO	HCT4-N	HCT6-N
REF. NO.	5236	5237
INSTRUCCIONES	Provisto de un tornillo integral. Torque de cierre recomendado 10 Ncm.	

TRANSFERENCIAS Y ANÁLOGOS





TIPO	Transfer bandeja abierta	
CÓDIGO	TST-N	TCT-N-R
REF. NO.	5231 (anti-rotacional) △	5248 (rotacional) ◯
INSTRUCCIONES	Provisto de tornillo 6012. Se recomienda cerrar manualmente.	



TIPO	Transfer bandeja cerrada
CÓDIGO	TS-N
REF. NO.	5235
INSTRUCCIONES	Se recomienda cerrar manualmente.

TIPO	Análogo
MATERIAL	Titanio
CÓDIGO	BTT-N
REF. NO.	5211

RESTAURACIÓN ATORNILLADA

Conexión Hexagonal Cónica (CHC)

PILARES RECTOS MULTIUNIT - PARA RESTARACIÓN HASTA 30°

DIMENSIONES	0.75 mm	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm	4.5 mm	5.5 mm
CÓDIGO	TCT-N 0.75-CHC	TCT-N 1.5-CHC	TCT-N 2.5-CHC	TCT-N 3.5-CHC	TCT-N 4.5-CHC	TCT-N 5.5-CHC
REF. NO.	5242	5243	5244	5245	5246	5247
INSTRUCCIONES	Uso 1. Destornillador de 5 mm para la inserción (consulte la página 20). Torque de cierre recomendado: 20 Ncm.*					

* No se recomienda para restaraciones de una sola pieza dental.

PILARES TEMPORARIOS

MATERIAL	Titanio
CÓDIGO	TTA-N
REF. NO.	5216
INSTRUCCIONES	Torque de cierre recomendado: 15 Ncm. Provisto de tornillo 6092.

CALCINABLES

MATERIAL	Plástico	Plástico
CÓDIGO	PST-N-AR	PST-N
REF. NO.	5217 (anti-rotacional) △	5218 (rotacional) ◯
INSTRUCCIONES	Se recomienda cerrar sólo manualmente (sin herramienta). Provisto de tornillo 6093.	

TORNILLO DE FIJACIÓN

MATERIAL	Titanio	Titanio revestido negro
CÓDIGO	SF-N	SFT-N
REF. NO.	6092	6093
INSTRUCCIONES	Utilice HTD 1,25 mm para la inserción. El tornillo 6093 es sólo para uso en laboratorio.	

PILARES ANGULADOS MULTIUNIT (DE DOS PIEZAS)

Alpha-Bio Tec recomienda a sus clientes que soliciten los nuevos componentes AlphaUniverse Multi Unit. Si las piezas todavía no están disponibles en su región, debido a las restricciones de la normativa, por favor, utilice la siguiente tabla para realizar el pedido:

ALPHA UNIBASE*				
	17°X2	17°X3	30°X2	30°X3
REF. NO.	7441	7442	7444	7445
PRO ALPHA UNICOVERS*				
CÓDIGO	AUC-T CT-N			
REF. NO.	5201			
TORNILLOS*				
CÓDIGO	USP		USL	
REF. NO.	5317		5318	

* Para obtener más información, consulte el folleto de la línea de restauración atornillada.

RESTAURACIÓN DE SOBREDENTADURAS

Conexión Hexagonal Cónica (CHC)

SISTEMA DE PILARES ALPHALOC

PILARES RECTOS (ALEACIÓN DE TITANIO CON RECUBRIMIENTO DE TiN (ESTAÑO))

DIMENSIONES	0.5 mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
REF. DEL KIT NO.	7470	7471	7472	7473	7474	7475
INSTRUCCIONES	Torque de cierre recomendado: 20 Ncm. El kit incluye: 1 retenedor de la altura indicada, 1 estructura metálica de acero inoxidable, 4 cofias de retención, 1 anillo espaciador, 1 cofia de laboratorio.					

PAQUETE DE REPUESTO

INCLUYE	Estructura de metal de acero inoxidable, anillo espaciador, machos de repuesto de nylon (violeta, transparente, rosa y amarillo), cofia de laboratorio (negro)
REF. NO.	4875

COFIAS MACHO DE REPUESTO

COLOR	Violeta (Retención fuerte)	Transparente (Retención estándar)	Rosa (Retención suave)	Amarillo (Retención extra suave)
REF. NO.	4876	4877	4878	4879
INCLUYE	4 unidades en cada kit			

SISTEMA DE RETENCIÓN DE BOLAS

PILARES DE TITANIO

DIMENSIONES	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
CÓDIGO	TB1-CHC	TB2-CHC	TB3-CHC	TB4-CHC	TB4-CHC
REF. NO.	7403	7404	7405	7406	7407
INSTRUCCIONES	Torque de cierre recomendado: 20 Ncm. NO sobrepasar 20 Ncm.				

COFIAS DE NYLON

MATERIAL	Estructura de acero inoxidable	Cofia de nylon	Cofia de nylon con anillo de titanio	Cofia de nylon suave
CÓDIGO	H	NC	NCT	NCA
REF. NO.	6240	6250	6251	6253

RESTAURACIÓN DE SOBREDENTADURAS

Conexión Hexagonal Cónica (CHC)

ACCESORIOS ALPHALOC

ANÁLOGO HEMBRA

CONTENIDO	4 unidades
REF. NO.	4885

HERRAMIENTA DE INSERCIÓN

CONTENIDO	1 unidad
REF. NO.	4886

HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN

CONTENIDO	1 unidad
REF. NO.	4887

COFIA DE LABORATORIO (NEGRA)

COLOR	Black
CONTENIDO	4 unidades
REF. NO.	4882

ANILLO ESPACIADOR

CONTENIDO	1 unidad
REF. NO.	4883

COFIA PARA IMPRESIÓN

CONTENIDO	1 unidad
REF. NO.	4884

PARTES PARA RESTAURACIÓN CAD/CAM

Conexión Hexagonal Cónica (CHC)

RESTAURACIÓN A NIVEL DEL IMPLANTE

BODY SCAN DE DOBLE USO

ALTURA	10 mm
CÓDIGO	SB-CHC
REF. NO.	5021
INSTRUCCIONES	Para laboratorio y uso intraoral. Máx: 10 Ncm.

TI-BASE RECTO (ANTI-ROTACIONAL)

ALTURA	0.7 mm / 5 mm	2.5 mm / 4 mm
CÓDIGO	CCTB-CHC	CCTB-CHC-2.5
REF. NO.	5026	4953
INSTRUCCIONES	Para restauraciones de una sola pieza dental. Torque de cierre recomendado: 20 Ncm.	

TI-BASE RECTO (ROTACIONAL)

ALTURA	0.7 mm / 5 mm	2.5 mm / 4 mm
CÓDIGO	CCTB-CHC-R	CCTB-CHC-R-2.5
REF. NO.	5027	4954
INSTRUCCIONES	Para restauraciones de una sola pieza dental. Torque de cierre recomendado: 20 Ncm.	

TI-BASE ANGULADO

ALTURA	0.5 mm / 5 mm
CÓDIGO	ACCTB-CHC
REF. NO.	5006
INSTRUCCIONES	Para restauraciones anguladas de una sola pieza dental. Torque de cierre recomendado: 20 Ncm.

BLOQUE PRE-FRESADO

MEDIDAS	Ø 11.5 / 20.2 mm
CÓDIGO	BA-PF-CHC
REF. NO.	4990
INSTRUCCIONES	Para el soporte de pilar PreFace®. Torque de cierre recomendado: 20 Ncm.

ANÁLOGO

CÓDIGO	IA-CHC
REF. NO.	4996
INSTRUCCIONES	Para todos los diámetros de implantes.

PARTES PARA RESTAURACIÓN CAD/CAM

Conexión Hexagonal Cónica (CHC)

RESTAURACIÓN A NIVEL DEL PILAR

BODY SCAN DE DOBLE USO*

ALTURA	7 mm	7 mm
CÓDIGO	IOSB-TCT-N-R	IOSB-TCT-N
REF. NO.	3883	5003
INSTRUCCIONES	Para la restauración de puentes con pilares rectos y angulados MultiUnit. Máx: 10 Ncm.	Para restauraciones de una sola corona con pilares angulados MultiUnit. Máx: 10 Ncm.

* Para utilizar con los tornillos 6092 y 6093.

COPINGS ADHESIVOS

ALTURA	3.5 mm	3.5 mm
CÓDIGO	TAC-TCT-N	TAC-TCT-N-R
REF. NO.	5028 (anti-rotacional) ⬡	5029 (rotacional) ◯
INSTRUCCIONES	Para restauraciones de una sola pieza dental	Para la restauración de barras/puentes

TORNILLO PARA MONTAJE DIRECTO*

CÓDIGO	S-DM-SR
REF. NO.	4994
INSTRUCCIONES	Para montaje directo sobre bastidor metálico

* No debe utilizarse para restauraciones completas de circonio o cerámica.

ANÁLOGO PARA TCT-N

CÓDIGO	BTT-N
REF. NO.	5211

COMPATIBLE CON SIRONA

TI BASE

CÓDIGO	CCTB-CHC-SI
REF. NO.	4982
INSTRUCCIONES	Para uso en escaneado y/o restauración. Torque de cierre recomendado: 20 Ncm.

BODY SCAN

CÓDIGO	CCSP-CHC-SI
REF. NO.	4985
INSTRUCCIONES	Para escaneado únicamente. Torque de cierre recomendado: 20 Ncm.

Para más información sobre las bibliotecas, visite **www.alpha-bio.net**.

SISTEMA NEO LA NUEVA SENSACIÓN

Conexión Hexagonal Interna (IH)

TIPOS DE HUESO	II, III, IV
CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE DISEÑO	• Cónico • Parte apical con características de centrado y anclaje • Dos micro espiras • Intercambio de plataforma
BENEFICIOS CLÍNICOS	• Óptima estabilidad primaria • Alta conservación ósea • Micro espiras que aumentan la superficie en un 20% • Aumento temprano del BIC

INFORMACIÓN DE PEDIDO

	Ø 3.75	Ø 4.2	Ø 5.0
8 mm	1168	1178	1188
10 mm	1160	1170	1180
11.5 mm	1161	1171	1181
13 mm	1163	1173	1183
16 mm	1166	1176	N/A

Importante: Pueden requerirse consideraciones profesionales para las adaptaciones del protocolo de fresado en casos específicos.

SISTEMA NEO LA NUEVA SENSACIÓN

Conexión Hexagonal Interna (IH)

PROTOCOLO DE FRESADO PARA FRESAS ESCALONADAS

Ø 3.75

Hueso Blando Tipo IV		Hueso Mediano Tipo II y III			Hueso Duro Tipo I			
Ø2.0	Ø2.4/Ø2.8	Ø2.0	Ø2.4/Ø2.8	Ø2.8/Ø3.2	Ø2.0	Ø2.4/Ø2.8	Ø2.8/Ø3.2	Ø3.2/Ø3.65 Cortical*



Ø 4.2

Hueso Blando Tipo IV			Hueso Mediano Tipo II y III			Hueso Duro Tipo I			
Ø2.0	Ø2.4/Ø2.8	Ø2.8/Ø3.2	Ø2.0	Ø2.4/Ø2.8	Ø3.2/Ø3.65	Ø2.0	Ø2.4/Ø2.8	Ø3.2/Ø3.65	Ø3.65/Ø4.1 Cortical*

Ø 5.0

Hueso Blando Tipo IV			Hueso Mediano Tipo II y III				Hueso Duro Tipo I					
Ø2.0	Ø2.4 / Ø2.8	Ø3.2 / Ø3.65	Ø2.0	Ø2.4 / Ø2.8	Ø3.2 / Ø3.65	Ø3.65 / Ø4.1	Ø2.0	Ø2.4 / Ø2.8	Ø3.2 / Ø3.65	Ø3.65 / Ø4.1	Ø4.1 / Ø4.5	Ø4.5 / Ø4.8 Cortical*

*** Cortical** – Fresar a través de la placa cortical con el diámetro más grande.

PROTOCOLO DE FRESADO PARA FRESAS RECTAS

Ø 3.75

Hueso Blando Tipo IV			Hueso Mediano Tipo II y III			Hueso Duro Tipo I			
Ø2.0	Ø2.4	Ø2.8**	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2**	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2**	Ø3.65 Cortical*



Ø 4.2

Hueso Blando Tipo IV			Hueso Mediano Tipo II y III				Hueso Duro Tipo I				
Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2**	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65**	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65**	Ø4.1 Cortical*



Ø 5.0

Hueso Blando Tipo IV				Hueso Mediano Tipo II y III					Hueso Duro Tipo I						
Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65**	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65	Ø4.1**	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65	Ø4.1	Ø4.5**	Ø4.8 Cortical*

*** Cortical** – Fresar a través de la placa cortical

** 3mm más corto que la longitud del implante. Tenga en cuenta que la fresa puede ser sustituida por la fresa escalonada correspondiente en toda la longitud del implante.

Para obtener más información, consulte el protocolo de fresado escalonado.

Spiral EL IMPLANTE ESPIRAL ORIGINAL

Conexión Hexagonal Interna (IH)

Spiral

TIPOS DE HUESO	III, IV
CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE DISEÑO	• Cuerpo condensador similar a un osteotomo • Núcleo cónico pronunciado • Parte apical con espiras profundas afiladas
BENEFICIOS CLÍNICOS	• Alta condensación ósea • Alta estabilidad inicial • Autoperforante • Capacidad de redireccionamiento durante la colocación • Penetración en diámetros pequeños

INFORMACIÓN DE PEDIDO*

	Ø 3.3	Ø 3.75	Ø 4.2	Ø 5.0	Ø 6.0
8 mm	1308	1358	1338	1348	1368
10 mm	1300	1350	1330	1340	1360
11.5 mm	1301	1351	1331	1341	1361
13 mm	1303	1353	1333	1343	1363
16 mm	1306	1356	1336	1346	N/A

Importante: Pueden requerirse consideraciones profesionales para las adaptaciones del protocolo de fresado en casos específicos.

* Para ver las medidas completas de implantes, visite www.alpha-bio.net

Spiral EL IMPLANTE ESPIRAL ORIGINAL

Conexión Hexagonal Interna (IH)

PROTOCOLO DE FRESADO CON FRESAS RECTAS

Ø 3.3

Hueso Blando Tipo IV	Hueso Mediano Tipo II y III		Hueso Duro Tipo I		
Ø2.0	Ø2.0	Ø2.8	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2 Cortical*



Ø 3.75

Hueso Blando Tipo IV		Hueso Mediano Tipo II y III			Hueso Duro Tipo I			
Ø2.0	Ø2.8	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65 Cortical*

Ø 4.2

Hueso Blando Tipo IV			Hueso Mediano Tipo II y III				Hueso Duro Tipo I				
Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65	Ø4.1 Cortical*



Ø 5.0

Hueso Blando Tipo IV				Hueso Mediano Tipo II y III					
Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65	Ø4.1	Ø4.5

Hueso Duro Tipo I						
Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65	Ø4.1	Ø4.5	Ø4.8 Cortical*

Ø 6.0

Hueso Blando Tipo IV						Hueso Mediano Tipo II y III						
Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65	Ø4.1	Ø4.8	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65	Ø4.1	Ø4.8	Ø5.2

Hueso Duro Tipo I							
Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65	Ø4.1	Ø4.8	Ø5.2	Ø5.8 Cortical*

* **Cortical** – Fresar a través de la placa cortical con el diámetro más grande.

IMPLANTE ICE PARA UNA ESTÉTICA SUPERIOR

Conexión Hexagonal Interna (IH)

TIPOS DE HUESO	I, II, III, IV
CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE DISEÑO	• Moderadamente cónico • Conicidad invertida** • Micro espiras coronales divididas
BENEFICIOS CLÍNICOS	• Mejor distribución del estrés • Soporta una amplia gama de casos clínicos • Penetración ósea controlada

Importante: Pueden requerirse consideraciones profesionales para las adaptaciones del protocolo de fresado en casos específicos.

PROTOCOLO DE FRESADO PARA FRESAS ESCALONADAS

Ø 3.7N

Hueso Blando Tipo IV		Hueso Mediano Tipo II y III			Hueso Duro Tipo I			
Ø2.0	Ø2.0/Ø2.4	Ø2.0	Ø2.4/Ø2.8	Ø2.8/Ø3.2	Ø2.0	Ø2.4/Ø2.8	Ø2.8/Ø3.2	Ø3.2/Ø3.65 Cortical*



Ø 3.75

Hueso Blando Tipo IV		Hueso Mediano Tipo II y III			Hueso Duro Tipo I			
Ø2.0	Ø2.4/Ø2.8	Ø2.0	Ø2.4/Ø2.8	Ø2.8/Ø3.2	Ø2.0	Ø2.4/Ø2.8	Ø2.8/Ø3.2	Ø3.2/Ø3.65 Cortical*



Ø 4.2

Hueso Blando Tipo IV			Hueso Mediano Tipo II y III			Hueso Duro Tipo I			
Ø2.0	Ø2.4/Ø2.8	Ø2.8/Ø3.2	Ø2.0	Ø2.4/Ø2.8	Ø3.2/Ø3.65	Ø2.0	Ø2.4/Ø2.8	Ø3.2/Ø3.65	Ø3.65/Ø4.1 Cortical*



Ø 4.65

Hueso Blando Tipo IV			Hueso Mediano Tipo II y III				Hueso Duro Tipo I				
Ø2.0	Ø2.4 / Ø2.8	Ø3.2 / Ø3.65	Ø2.0	Ø2.4 / Ø2.8	Ø3.2 / Ø3.65	Ø3.65 / Ø4.1	Ø2.0	Ø2.4 / Ø2.8	Ø3.2 / Ø3.65	Ø3.65 / Ø4.1	Ø4.1 / Ø4.5 Cortical*



Ø 5.3

Hueso Blando Tipo IV				Hueso Mediano Tipo II y III					Hueso Duro Tipo I					
Ø2.0	Ø2.4 / Ø2.8	Ø3.2 / Ø3.65	Ø3.65 / Ø4.1	Ø2.0	Ø2.4 / Ø2.8	Ø3.2 / Ø3.65	Ø3.65 / Ø4.1	Ø4.5 / Ø4.8	Ø2.0	Ø2.4 / Ø2.8	Ø3.2 / Ø3.65	Ø3.65 / Ø4.1	Ø4.5 / Ø4.8	Ø4.8 / Ø5.2 Cortical*

* **Cortical** – Fresar a través de la placa cortical con el diámetro más grande.

** Implantes ICE de Ø4,2, Ø4,65 y Ø5,3 en longitudes a partir de 10 mm.

IMPLANTE ICE PARA UNA ESTÉTICA SUPERIOR

Conexión Hexagonal Interna (IH)

INFORMACIÓN DE PEDIDO

	Ø 3.7N	Ø 3.75	Ø 4.2	Ø 4.65	Ø 5.3
6 mm	N/A	N/A	1056	1036	1046
8 mm	N/A	1018	1028	1038	1048
10 mm	1000	1010	1020	1030	1040
11.5 mm	1001	1011	1021	1031	1041
13 mm	1003	1013	1023	1033	1043
16 mm	N/A	1016	1026	N/A	N/A

PROTOCOLO DE FRESADO PARA FRESAS RECTAS

Ø 3.7N

Hueso Blando Tipo IV		Hueso Mediano Tipo II y III			Hueso Duro Tipo I			
Ø2.0	Ø2.4**	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2**	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2**	Ø3.65 Cortical*

Ø 3.75

Hueso Blando Tipo IV			Hueso Mediano Tipo II y III			Hueso Duro Tipo I			
Ø2.0	Ø2.4	Ø2.8**	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2**	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2**	Ø3.65 Cortical*

Ø 4.2

Hueso Blando Tipo IV			Hueso Mediano Tipo II y III				Hueso Duro Tipo I				
Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2**	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65**	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65**	Ø4.1 Cortical*



Ø 4.65

Hueso Blando Tipo IV				Hueso Mediano Tipo II y III				
Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65**	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65	Ø4.1**

Hueso Duro Tipo I					
Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65	Ø4.1**	Ø4.5 Cortical*

Ø 5.3

Hueso Blando Tipo IV					Hueso Mediano Tipo II y III						
Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65	Ø4.1**	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65	Ø4.1	Ø4.5	Ø4.8**

Hueso Duro Tipo I							
Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65	Ø4.1	Ø4.5	Ø4.8**	Ø5.2 Cortical*

*** Cortical** – Fresar a través de la placa cortical

** 3mm más corto que la longitud del implante. Tenga en cuenta que la fresa puede ser sustituida por la fresa escalonada correspondiente en toda la longitud del implante.

Para obtener más información, consulte el protocolo de fresado escalonado.

ATID IMPLANTE ESTÁNDAR CON PAREDES PARALELAS

Conexión Hexagonal Interna (IH)

ATID

TIPOS DE HUESO	I, II
CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE DISEÑO	• Cilíndrico • Paredes paralelas • Espiras uniformes • Amplia superficie
BENEFICIOS CLÍNICOS	• Mayor superficie de BIC • Presión mínima sobre el hueso • Inserción homogénea

INFORMACIÓN DE PEDIDO

	Ø 3.75	Ø 4.2	Ø 5.0
6 mm	N/A	N/A	1446
8 mm	1428	1438	1448
10 mm	1420	1430	1440
11.5 mm	1421	1431	1441
13 mm	1423	1433	1443

Importante: Pueden requerirse consideraciones profesionales para las adaptaciones del protocolo de fresado en casos específicos.

PROTOCOLO DE FRESADO PARA FRESAS RECTAS

Ø 3.75

Hueso Blando Tipo IV			Hueso Mediano Tipo II y III			Hueso Duro Tipo I			
Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2 Cortical*	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65 Cortical*

Ø 4.2

Hueso Blando Tipo IV				Hueso Mediano Tipo II y III				Hueso Duro Tipo I				
Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65 Cortical*	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65	Ø4.1 Cortical*

Ø 5.0

Hueso Blando Tipo IV						Hueso Mediano Tipo II y III					
Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65	Ø4.1	Ø4.5 Cortical*	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65	Ø4.1	Ø4.5

Hueso Duro Tipo I						
Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65	Ø4.1	Ø4.5	Ø4.8 Cortical*

*** Cortical** – Fresar a través de la placa cortical

DFI IMPLANTE DE AJUSTE DUAL

Conexión Hexagonal Interna (IH)

DFI

TIPOS DE HUESO	I, II, III
CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE DISEÑO	• Ligeramente cónico • Diseño de doble espira con espiras variables • Ápice con estrías de corte
BENEFICIOS CLÍNICOS	• Fácilmente estabilizado y controlado durante la colocación • Estabilidad a largo plazo • Amplia superficie

INFORMACIÓN DE PEDIDO

	Ø 3.3	Ø 3.75	Ø 4.2	Ø 5.0
8 mm	1288	1268	1278	1298
10 mm	1280	1260	1270	1290
11.5 mm	1281	1261	1271	1291
13 mm	1283	1263	1273	1293

Importante: Pueden requerirse consideraciones profesionales para las adaptaciones del protocolo de fresado en casos específicos.

PROTOCOLO DE FRESADO PARA FRESAS RECTAS

Ø 3.3

Hueso Blando Tipo IV		Hueso Mediano Tipo II y III		Hueso Duro Tipo I		
Ø2.0	Ø2.8 Cortical*	Ø2.0	Ø2.8	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2 Cortical*

Ø 3.75

Hueso Blando Tipo IV			Hueso Mediano Tipo II y III			Hueso Duro Tipo I			
Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2 Cortical*	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65 Cortical*

Ø 4.2

Hueso Blando Tipo IV				Hueso Mediano Tipo II y III				Hueso Duro Tipo I				
Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65 Cortical*	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65	Ø4.1 Cortical*

Ø 5.0

Hueso Blando Tipo IV						Hueso Mediano Tipo II y III					
Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65	Ø4.1	Ø4.5 Cortical*	Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65	Ø4.1	Ø4.5

Hueso Duro Tipo I						
Ø2.0	Ø2.8	Ø3.2	Ø3.65	Ø4.1	Ø4.5	Ø4.8 Cortical*

*** Cortical –** Fresar a través de la placa cortical.

HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN & PILARES DE CICATRIZACIÓN

Conexión Hexagonal Interna (IH)

HERRAMIENTAS DE INSERCIÓN DE IMPLANTES

DESTORNILLADOR MANUAL 2.5 MM

LONGITUD	12 mm
CÓDIGO	MITD2.5-IH
REF. NO.	4146
INSTRUCCIONES	Para uso manual

ESTORNILLADOR DE INSERCIÓN 2.5 MM

LONGITUD	16 mm	10 mm	6 mm
CÓDIGO	G-ITDL2.5	G-ITDM2.5	G-ITDS2.5
REF. NO.	4140	4141	4142
INSTRUCCIONES	Compatible con llave hexagonal de 6.35 mm o llave criquet cuadrada de 4 mm		

CONTRA ÁNGULO 2.5 MM

LONGITUD	23 mm	16 mm
CÓDIGO	GITL2.5/1.25	GITS2.5/1.25
REF. NO.	4143	4145
INSTRUCCIONES	Para ser usado con un motor de contra ángulo	

PILARES DE CICATRIZACIÓN*

Ø 3.85

ALTURA	3 mm	4 mm	5 mm
CÓDIGO	HSS3	HSS4	HSS5
REF. NO.	112	114	113

Ø 4.6

ALTURA	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	7 mm
CÓDIGO	HS2	HS3	HS4	HS5	HS6	HS7
REF. NO.	116	109	117	110	118	119

PILARES DE CICATRIZACIÓN ANCHOS

DIÁMETRO	Ø 5.0	Ø 5.0	Ø 5.5	Ø 5.5	Ø 6.0	Ø 6.0	Ø 7.0
ALTURA	3 mm	5 mm	3 mm	5 mm	3 mm	5 mm	3 mm
CÓDIGO	HS5-3	HS5-5	HS5.5-3	HS5.5-5	HS6-3	HS6-5	HS7-3
REF. NO.	124	125	126	127	128	129	130

* Torque de cierre recomendado: 10 Ncm.

RESTAURACIÓN CEMENTADA

Conexión Hexagonal Interna (IH)

IMPRESIÓN

TRANSFER DE BANDEJA ABIERTA



CÓDIGO	HLTO	HLTOS
REF. NO.	5061	5171
OBSERVACIÓN	Cada transfer se suministra con su tornillo correspondiente. Máx: 10 Ncm.	

TRANSFER DE BANDEJA CERRADA

CÓDIGO	HLT	HLTS	HLTLS
REF. NO.	5060 (Largo)	5170	5062 (Delgado)
OBSERVACIÓN	Cada transfer se suministra con su tornillo correspondiente. Máx: 10 Ncm.		

TRANSFER PLÁSTICO

CÓDIGO	HTLASP
REF. NO.	5364
OBSERVACIÓN	Para uso con los pilares 5366, 5367, 5368, 5369, 5352, 5353, 5354, 5355.

ANÁLOGOS DE IMPLANTE

DIÁMETRO	Ø 4.2	Ø 5.0
CÓDIGO	IA	IA5
REF. NO.	5080	5280
INSTRUCCIONES	5080 es compatible con todos los diámetros de implantes. 5280 no es compatible con los implantes ICE ni NeO.	

RESTAURACIÓN CEMENTADA

Conexión Hexagonal Interna (IH)

PILARES DE TITANIO*

RECTO Ø 4,5

ALTURA	1.7 mm / 12.5 mm	1.7 mm / 8.5 mm
CÓDIGO	TLAL	TLA
REF. NO.	5140	5030

RECTO Ø 4.8

ALTURA	1 mm / 8.9 mm	2 mm / 9.9 mm	3 mm / 10.9 mm	4 mm / 11.9 mm
CÓDIGO	TLASP1	TLASP2	TLASP3	TLASP4
REF. NO.	5366	5367	5368	5369

DELGADO Ø 3.85

ALTURA	0.8 mm / 8.5 mm	0.5 mm / 8.5 mm
CÓDIGO	TLAS	TLASSP
REF. NO.	5150	5403

ANCHO - DIFERENTES DIÁMETROS

DIÁMETRO	Ø 5.6	Ø 5.6	Ø 4.5	Ø 4.5	Ø 4.5
ALTURA	2 mm / 9.5 mm	4 mm / 11.5 mm	1.2 mm / 8.5 mm	3.2 mm / 8.5 mm	3.2 mm / 12.5 mm
CÓDIGO	TLAO2	TLAO4	TLAW	TLAWP	TLAWPL
REF. NO.	5182	5362	5340	5401	5402

ANGULADO 15°

ALTURA	1.7 mm / 8.5 mm	1.65 mm / 11.5 mm	2.3 mm / 8.5 mm	1.5 mm / 9 mm
CÓDIGO	TLA 15	TLAL 15	TLA 15B	TLA 15BB
REF. NO.	5090	5092	5091	5098

ANGULADO 25°

ALTURA	1.8 mm / 8.5 mm	2.4 mm / 11.5 mm
CÓDIGO	TLA 25	TLAL 25
REF. NO.	5130	5134

ANGULADO 35°

ALTURA	1.45 mm / 10 mm
CÓDIGO	TLA 35
REF. NO.	5136
INSTRUCCIONES	Suministrado con un tornillo dedicado (Ref. No. 5127).

* Torque de cierre recomendado: 30 Ncm.

RESTAURACIÓN CEMENTADA

Conexión Hexagonal Interna (IH)

PILARES PROVISORIOS

RECTO (PILARES PEEK)

ALTURA	1 mm	2 mm	3 mm
CÓDIGO	TPA1	TPA2	TPA3
REF. NO.	5416	5417	5418
INSTRUCCIONES	Torque de cierre recomendado: 15 Ncm. Adecuado para restauraciones cementadas o atornilladas. Vida útil sólo por 180 días.		

ANGULADO 15° (PILARES PEEK)

ALTURA	1 mm	2 mm	3 mm
CÓDIGO	TPA 15-1	TPA 15-2	TPA 15-3
REF. NO.	5419	5420	5421
INSTRUCCIONES	Torque de cierre recomendado: 15 Ncm. Adecuado para restauraciones cementadas o atornilladas. Vida útil sólo por 180 días.		

ANGULADO 25° (PILARES PEEK)

ALTURA	1 mm	2 mm
CÓDIGO	TPA 25-1	TPA 25-2
REF. NO.	5422	5423
INSTRUCCIONES	Torque de cierre recomendado: 15 Ncm. Adecuado para restauraciones de cementadas o atornilladas. Vida útil sólo por 180 días.	

RECTO (PILARES DE TITANIO)

ALTURA	1.7 mm	1.7 mm
CÓDIGO	TLAC-AR	TLAC-R
REF. NO.	5200 (anti-rotacional) ⬡	5220 (rotacional) ◯
INSTRUCCIONES	Torque de cierre recomendado: 30Ncm.	Utilizado para restauraciones de unidades múltiples.

RESTAURACIÓN CEMENTADA

Conexión Hexagonal Interna (IH)

PILARES ESTÉTICOS*

RECTO Ø 4.8

DIÁMETRO	0.9 mm / 8.9 mm	1.9 mm / 9.9 mm	2.9 mm / 10.9 mm	3.9 mm / 11.9 mm
CÓDIGO	ETLASP1	ETLASP2	ETLASP3	ETLASP4
REF. NO.	5352	5353	5354	5355
INSTRUCCIONES	Use un transfer de plástico a presión (Ref. No. 5364) para la impresión de bandeja cerrada.			

RECTO - DIÁMETROS DIFERENTES

DIÁMETRO	Ø 4.5	Ø 3.85
ALTURA	1.7 mm / 8.5 mm	0.8 mm / 8.5 mm
CÓDIGO	ETLA	ETLAS
REF. NO.	5031	5155 (Slim)

ANGULADO 15°

ALTURA	1.65 mm / 11.5 mm
CÓDIGO	ETLAL 15
REF. NO.	5094

ANGULADO 25°

ALTURA	1.8 mm / 8.5 mm
CÓDIGO	ETLAL 25
REF. NO.	5131

PILARES ESTÉTICOS ANATÓMICOS

ANGULADO 15°

DIÁMETRO	Ø 5.1	Ø 5.1	Ø 5.1
ALTURA	1.6 mm / 8.7 mm	2.6 mm / 9.7 mm	3.6 mm / 10.6 mm
CÓDIGO	EAAS 15	EAA 15	EAAH 15
REF. NO.	5410	5411	5412
INSTRUCCIONES	Diseñado especialmente para premolares y molares.		

ANGULADO 25°

DIÁMETRO	Ø 5.3	Ø 5.3	Ø 5.3
ALTURA	1.6 mm / 9 mm	2.5 mm / 9.9 mm	3.7 mm / 10.9 mm
CÓDIGO	EAAS 25	EAA 25	EAAH 25
REF. NO.	5413	5414	5415
INSTRUCCIONES	Diseñado especialmente para premolares y molares.		

*Torque de cierre recomendado: 30 Ncm.

MOLDEADO Y TORNILLOS

Conexión Hexagonal Interna (IH)

PILARES CALCINABLES

PILARES PLÁSTICOS

DIÁMETRO	Ø 4.5	Ø 4.5	Ø 3.85	Ø 4.5 (Angulado)
ALTURA	1.7 mm	1.7 mm	N/A	1.7 mm
CÓDIGO	PLA	PLA-R	PLAS	PLA 15
REF. NO.	5040 ⬡ (anti-rotacional)	5041 ◯ (rotacional)	5050 ⬡ (anti-rotacional)	5093 ⬡ (anti-rotacional)
INSTRUCCIONES	Los pilares anti-rotacionales se pueden utilizar para la restauración en implantes simples o múltiples. Los pilares rotacionales se pueden usar para restauraciones en implantes múltiples solamente.			

PILARES BASE CoCr

TEMPERATURA DE FUSIÓN CoCr	>1290°C - 1380°C
CÓDIGO	TLABCC
REF. NO.	6405 (anti-rotacional) ⬡

TEMPERATURA DE FUSIÓN CoCr	>1290°C - 1380°C
CÓDIGO	TLABCC-R Rotational
REF. NO.	6406 (rotacional) ◯

TORNILLOS

USO	Clínico	Para laboratorio	Para TLA35	Recuperación
CÓDIGO	STLAS	STLAT	STLASH	RS
REF. NO.	5122	5121*	5127**	5110***
INSTRUCCIONES	Use 30 Ncm para ajustar los tornillos. *Recubrimiento especial, solo para uso en laboratorio. **Utilizar solo con pilar TLA35 (Ref. No. 5136). ***Se adapta a las plataformas IH y CS.			

* Torque de cierre recomendado: 30Ncm.

PILARES ANGULADOS MULTIUNIT



17°

ALTURA	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm
CÓDIGO	AU 17-1.5 IH	AU 17-2.5 IH	AU 17-2.5 IH
REF. NO.	5432	5433	5434
INSTRUCCIONES	Utilice un destornillador de 1,25 mm para la inserción (consulte la página 20). Torque de cierre recomendado: 30 Ncm.		

30°

ALTURA	1.5 mm	2.5 mm	3.5 mm
CÓDIGO	AU 30-1.5 IH	AU 30-2.5 IH	AU 30-2.5 IH
REF. NO.	5437	5438	5439
INSTRUCCIONES	Utilice un destornillador de 1,25 mm para la inserción (consulte la página 20). Torque de cierre recomendado: 30 Ncm.		

PILAR RECTO MULTIUNIT - PARA RESTAURACIÓN HASTA 30°

ALTURA	0.75 mm	1.6 mm	2.6 mm	3.6 mm	4.6 mm	5.6 mm
CÓDIGO	TCT0.5-N	TCT1.5-N	TCT2.5-N	TCT3.5-N	TCT4.5-N	TCT5.5-N
REF. NO.	5221	5222	5223	5252	5253	5254
INSTRUCCIONES	Utilice un destornillador hexagonal de 1.5mm para la inserción (véase la página 20). Torque de cierre recomendado: 30 Ncm.*					

* No se recomienda para restauraciones de una sola pieza dental.

PILARES RECTOS - PARA RESTAURACIÓN DE IMPLANTES ÚNICOS

ALTURA	0.5 mm	1.5 mm	2.5 mm
CÓDIGO	HBC 0.5	HBC 1.5	HBC 2.5
REF. NO.	6040	6041	6042
INSTRUCCIONES	Utilice un destornillador de 1,25 mm con un torque de 30 Ncm. Los pilares se suministran con un tornillo correspondiente (6050, 6051, 6052) y un calcinable (6070).		

PILARES DE CICATRIZACIÓN*

ALTURA	4 mm	6 mm
CÓDIGO	HCT4-N	HCT6-N
REF. NO.	5236	5237
INSTRUCCIONES	Provisto de un tornillo integral. Torque de cierre recomendado 10 Ncm.	

TORNILLO DE FIJACIÓN

MATERIAL	Titanio	Titanio revestido negro
TORNILLO DE FIJACIÓN	SF-N	SFT-N
REF. NO.	6092	6093
INSTRUCCIONES	Utilice HTD 1,25 mm para la inserción. El tornillo 6093 es sólo para uso en laboratorio.	

RESTAURACIÓN ATORNILLADA

Conexión Hexagonal Interna (IH)

TRANSFER Y ANÁLOGOS



TIPO	Transfer bandeja abierta	
CÓDIGO	TST-N	TCT-N-R
REF. NO.	5231 (anti-rotacional) △	5248 (rotacional) ◯
INSTRUCCIONES	Provisto de tornillo 6012. Se recomienda cerrar manualmente.	

TIPO	Transfer de bandeja cerrada
CÓDIGO	TS-N
REF. NO.	5235
INSTRUCCIONES	Se recomienda cerrar manualmente.

TIPO	Análogo
MATERIAL	Titanio
CÓDIGO	BTT-N
REF. NO.	5211

PILARES PROVISORIOS

MATERIAL	Titanio
CÓDIGO	TTA-N
REF. NO.	5216
INSTRUCCIONES	Torque de cierre recomendado: 25 Ncm. Provisto de tornillo 6092.

CALCINABLES

MATERIAL	Plástico	Plástico
CÓDIGO	PST-N-AR	PST-N
REF. NO.	5217 (anti-rotacional) △	5218 (rotacional) ◯
INSTRUCCIONES	Se recomienda cerrar sólo manualmente (sin herramienta). Provisto de tornillo 6093.	

PILARES ANGULADOS MULTIUNIT (DE DOS PIEZAS)

Alpha-Bio Tec recomienda a sus clientes que ordenen las soliciten los nuevos componentes de diseño AlphaUniverse Multi Unit.
Si estos todavía no están disponibles en su región, debido a las restricciones de la normativa, por favor, utilice la siguiente tabla para realizar el pedido:

ALPHA UNIBASE*				
	17° X 1.5	17° X 2.5	30° X 1.5	30° X 2.5
REF. NO.	5308	5309	5312	5313

PRO ALPHA UNICOVERS*	
CÓDIGO	AUC-T CT-N
REF. NO.	5201

TORNILLOS*		
CÓDIGO	USP	USL
REF. NO.	5314	5315

* Para obtener más información, consulte el folleto de la línea de restauración atornillada.

RESTAURACIÓN DE SOBREDENTADURAS

Conexión Hexagonal Interna (IH)

SISTEMA DE PILARES ALPHALOC

PILARES RECTOS (ALEACIÓN DE TITANIO CON RECUBRIMIENTO DE ESTAÑO (TiN)

ALTURA	0.5 mm	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
REF. DEL KIT NO.	4867	4868	4869	4870	4871	4872
INSTRUCCIONES	Torque de cierre recomendado: 30 Ncm. El kit incluye: 1 retenedor de la altura indicada, 1 estructura metálica de acero inoxidable, 4 cofias de retención, 1 anillo espaciador, 1 cofia de laboratorio.					

PAQUETE DE REPUESTO

INCLUYE	Estructura de metal de acero inoxidable, anillo espaciador, machos de nylon de repuesto (violeta, transparente, rosa y amarillo), cofia de laboratorio (negra).
REF. NO.	4875

COFIAS MACHO DE REPUESTO

COLOR	Violeta (Retención fuerte)	Transparente (Retención estándar)	Rosa (Retención suave)	Amarillo (Retención extra suave)
REF. NO.	4876	4877	4878	4879
INCLUYE	4 unidades en cada kit.			

SISTEMA DE RETENEDORES DE BOLAS

RETENEDORES DE BOLA RECTOS

ALTURA	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
CÓDIGO	TB 0.5	TB 2	TB 3	TB 4	TB 5	TB 6
REF. NO.	6260	6210	6280	6220	6270	6290
INSTRUCCIONES	Para la impresión, utilice el método de transfer y análogo (véase la página 57). Utilice el destornillador 1.25 para la inserción (consulte la página 20). Utilizar cofia de nylon ø 2,5 mm.					

RETENEDORES DE BOLA ANGULADA

ALTURA	3 mm	4 mm
CÓDIGO	TBAA2	TBAA3
REF. NO.	6304	6306
INSTRUCCIONES	La bola está orientada a la superficie plana del hexágono.	

TAPONES DE NYLON

MATERIAL	Estructura de acero inoxidable	Cofia de nylon	Cofia de nylon con anillo de titanio	Cofia de nylon suave
CÓDIGO	H	NC	NCT	NCA
REF. NO.	6240	6250	6251	6253

RESTAURACIÓN DE SOBREDENTADURAS

Conexión Hexagonal Interna (IH)

ACCESORIOS ALPHALOC

ANÁLOGO HEMBRA

CONTENIDO	4 unidades
REF. NO.	4885

HERRAMIENTA DE INSERCIÓN

CONTENIDO	1 unidad
REF. NO.	4886

HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN

CONTENIDO	1 unidad
REF. NO.	4887

COFIA DE LABORATORIO (NEGRA)

COLOR	Negro
CONTENIDO	4 unidades
REF. NO.	4882

ANILLO ESPACIADOR

CONTENIDO	1 unidad
REF. NO.	4883

COFIA PARA IMPRESIÓN

CONTENIDO	1 unidad
REF. NO.	4884

PARTES PARTES PARA
RESTAURACIÓN CAD/CAM

Conexión Hexagonal Interna (IH)

RESTAURACIÓN A NIVEL DEL IMPLANTE

BODY SCAN DE DOBLE USO

DIÁMETRO	10 mm
CÓDIGO	SB-IH
REF. NO.	5019
INSTRUCCIONES	Usar destornillador estándar (Ref. No. 4052). Máx: 10 Ncm.

TI-BASE RECTO

DIÁMETRO	0.7 mm / 5.7 mm	2.5 mm / 6.5 mm	0.7 mm / 5.7 mm	2.5 mm / 6.5 mm
CÓDIGO	CCTB ⬡	CCTB-2.5 ⬡	CCTB-R ◯	CCTB-R-2.5 ◯
REF. NO.	5024 (anti-rotacional)*	4951 (anti-rotacional)*	5025 (rotacional)**	4952 (rotacional)**
INSTRUCCIONES	*Para restauraciones de una sola pieza dental. Torque de cierre recomendado: 30 Ncm.		**Para la restauración de puentes/barras. Torque de cierre recomendado: 30 Ncm.	

TI-BASE ANCHO

DIÁMETRO	0.7 mm / 4.2 mm	0.7 mm / 4.2 mm
CÓDIGO	WCCTB	WCCTB-R
REF. NO.	5007 (anti-rotacional) ⬡	5008 (rotacional) ◯
INSTRUCCIONES	Para restauraciones de una sola pieza dental. Torque de cierre recomendado: 30 Ncm.	Para la restauración de puentes/barras. Torque de cierre recomendado: 30 Ncm.

TI-BASE ANGULADO

DIÁMETRO	5 mm / 5.5 mm
CÓDIGO	ACCTB
REF. NO.	5005
INSTRUCCIONES	Para la restauración angulada de una sola pieza dental. Torque de cierre recomendado: 30 Ncm.

BLOQUE PRE-FRESADO (TORNILLO INCLUIDO)

DIÁMETRO	Ø 11.5	Ø 15.8
CÓDIGO	BA-PF-IH	WBA-PF-IH
REF. NO.	4988	4989
INSTRUCCIONES	Para el soporte de pilar PreFace®. Torque de cierre recomendado: 30 Ncm.	

ANÁLOGO

CÓDIGO	AN-PM
REF. NO.	4995
INSTRUCCIONES	Utilizado para modelos impresos.

PARTES PARTES PARA
RESTAURACIÓN CAD/CAM

Conexión Hexagonal Interna (IH)

RESTAURACIÓN A NIVEL DEL PILAR

BODY SCAN DE DOBLE USO

ALTURA	7 mm	7 mm
CÓDIGO	IOSB-TCT-N-R	IOSB-TCT-N
REF. NO.	3883 (anti-rotacional)	5003 (rotacional)
INSTRUCCIONES	Para la restauración de puentes con pilares rectos y angulados MultiUnit. Máx: 10 Ncm.	Para restauraciones de una sola corona con pilares angulados MultiUnit. Utilice el destornillador estándar (4052). Máx: 10 Ncm.

COPING ADHESIVO

ALTURA	3.5 mm	3.5 mm
CÓDIGO	TAC-TCT-N	TAC-TCT-N-R
REF. NO.	5028 (anti-rotacional) ⬡	5029 (rotacional) ◯
INSTRUCCIONES	Para restauraciones de un solo diente.	Para restauración de barra/puente.

TORNILLO PARA MONTAJE DIRECTO*

CÓDIGO	S-DM-SR
REF. NO.	4994
INSTRUCCIONES	Para montaje directo sobre bastidor metálico.

* No debe utilizarse para restauraciones completas de zirconia o cerámica.

ANÁLOGO PARA TCT-N

CÓDIGO	BTT-N
REF. NO.	5211
INSTRUCCIONES	Adecuado para TCT-N y TCT-N-R. También para modelo impreso.

COMPATIBLE CON SIRONA

BASE-TI

CÓDIGO	CCTB-IH-SI
REF. NO.	4980
INSTRUCCIONES	Para uso en escaneado y/o restauración. Torque de cierre recomendado: 30 Ncm.

BODY SCAN

CÓDIGO	CCSP-IH-SI
REF. NO.	4984
INSTRUCCIONES	Sólo para propósitos de escaneo. Torque de cierre recomendado: 30 Ncm.

Para más información sobre las bibliotecas, visite **www.alpha-bio.net**.

LISTA DE PRODUCTOS Y REF. NO.

LISTA DE PRODUCTOS Y REF. NO.

NÚMERO DE REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁGINA NO.
109	HS3	Pilar de cicatrización L3.0mm	56
110	HS5	Pilar de cicatrización L5.0mm	56
112	HSS3	Pilar de cicatrización delgado L3.0mm	56
113	HSS5	Pilar de cicatrización delgado L5.0mm	56
114	HSS4	Pilar de cicatrización delgado L4.0mm	56
116	HS2	Pilar de cicatrización L2.0mm	56
117	HS4	Pilar de cicatrización L4.0mm	56
118	HS6	Pilar de cicatrización L6.0mm	56
119	HS7	Pilar de cicatrización L7.0mm	56
124	HS5-3	Pilar de cicatrización D5.0 H3.0mm	56
125	HS5-5	Pilar de cicatrización D5.0 H5.0mm	56
126	HS5.5-3	Pilar de cicatrización D5.5 L3.0mm	56
127	HS5.5-5	Pilar de cicatrización D5.5 H5.0mm	56
128	HS6-3	Pilar de cicatrización D6.0 H3.0mm	56
129	HS6-5	Pilar de cicatrización D6.0 H5.0mm	56
130	HS7-3	Pilar de cicatrización D7.0 H3.0mm	56
1000	ICE	Implante Clásico Estético angosto D3.7mm L10mm	53
1001	ICE	Implante Clásico Estético angosto D3.7mm L11.5mm	53
1003	ICE	Implante Clásico Estético angosto D3.7mm L13mm	53
1010	ICE	Implante Clásico Estético D3.75mm L10mm	53
1011	ICE	Implante Clásico EstéticoD3.75mm L11.5mm	53
1013	ICE	Implante Clásico Estético D3.75mm L13mm	53
1016	ICE	Implante Clásico Estético D3.75mm L16mm	53
1018	ICE	Implante Clásico Estético D3.75mm L8mm	53
1020	ICE	Implante Clásico Estético D4.2mm L10mm	53
1021	ICE	Implante Clásico Estético D4.2mm L11.5mm	53
1023	ICE	Implante Clásico Estético D4.2mm L13mm	53
1026	ICE	Implante Clásico Estético D4.2mm L16mm	53
1028	ICE	Implante Clásico Estético D4.2mm L8mm	53
1030	ICE	Implante Clásico Estético D4.65mm L10.0mm	53
1031	ICE	Implante Clásico Estético D4.65mm L11.5mm	53
1033	ICE	Implante Clásico Estético D4.65mm L13.0mm	53
1036	ICE	Implante Clásico Estético D4.65mm L6.0mm	53
1038	ICE	Implante Clásico Estético D4.65mm L8.0mm	53
1040	ICE	Implante Clásico Estético D5.3mm L10mm	53
1041	ICE	Implante Clásico Estético D5.3mm L11.5mm	53
1043	ICE	Implante Clásico Estético D5.3mm L13mm	53
1046	ICE	Implante Clásico Estético D5.3mm L6mm	53
1048	ICE	Implante Clásico Estético D5.3mm L8mm	53
1056	ICE	Implante Clásico Estético D4.2mm L6mm	53
1060	NICE	NICE D3.2mm L10mm	37
1061	NICE	NICE D3.2mm L11.5mm	37
1063	NICE	NICE D3.2mm L13mm	37
1066	NICE	NICE D3.2mm L16mm	37
1068	NICE	NICE D3.2mm L8mm	37

LISTA DE PRODUCTOS Y REF. NO.

NÚMERO DE REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁGINA NO.
1100	NEO CHC	Neo C D3.2mm L10.0mm	36
1101	NEO CHC	Neo C D3.2mm L11.5mm	36
1103	NEO CHC	Neo C D3.2mm L13.0mm	36
1106	NEO CHC	Neo C D3.2mm L16.0mm	36
1108	NEO CHC	Neo C D3.2mm L8.0mm	36
1120	NEO CHC	Neo C D3.5mm L10.0mm	36
1121	NEO CHC	Neo C D3.5mm L11.5mm	36
1123	NEO CHC	Neo C D3.5mm L13.0mm	36
1126	NEO CHC	Neo C D3.5mm L16.0mm	36
1128	NEO CHC	Neo C D3.5mm L8.0mm	36
1130	NEO CS	Neo CS D3.75mm L10.0mm	24
1131	NEO CS	Neo CS D3.75mm L11.5mm	24
1133	NEO CS	Neo CS D3.75mm L13.0mm	24
1136	NEO CS	Neo CS D3.75mm L16.0mm	24
1138	NEO CS	Neo CS D3.75mm L8.0mm	24
1140	NEO CS	Neo CS D4.2mm L10.0mm	24
1141	NEO CS	Neo CS D4.2mm L11.5mm	24
1143	NEO CS	Neo CS D4.2mm L13.0mm	24
1146	NEO CS	Neo CS D4.2mm L16.0mm	24
1148	NEO CS	Neo CS D4.2mm L8.0mm	24
1150	NEO CS	Neo CS D5.0mm L10.0mm	24
1151	NEO CS	Neo CS D5.0mm L11.5mm	24
1153	NEO CS	Neo CS D5.0mm L13.0mm	24
1158	NEO CS	Neo CS D5.0mm L8.0mm	24
1160	NEO IH	Neo H D3.75mm L10.0mm	48
1161	NEO IH	Neo H D3.75mm L11.5mm	48
1163	NEO IH	Neo H D3.75mm L13.0mm	48
1166	NEO IH	Neo H D3.75mm L16.0mm	48
1168	NEO IH	Neo H D3.75mm L8.0mm	48
1170	NEO IH	Neo H D4.2mm L10.0mm	48
1171	NEO IH	Neo H D4.2mm L11.5mm	48
1173	NEO IH	Neo H D4.2mm L13.0mm	48
1176	NEO IH	Neo H D4.2mm L16.0mm	48
1178	NEO IH	Neo H D4.2mm L8.0mm	48
1180	NEO IH	Neo H D5.0mm L10.0mm	48
1181	NEO IH	Neo H D5.0mm L11.5mm	48
1183	NEO IH	Neo H D5.0mm L13.0mm	48
1188	NEO IH	Neo H D5.0mm L8.0mm	48
1260	DFI	Implante Dual Fit D3.75mm L10.0mm	55
1261	DFI	Implante Dual Fit D3.75mm L11.5mm	55
1263	DFI	Implante Dual Fit D3.75mm L13.0mm	55
1266	DFI	Implante Dual Fit D3.75mm L16.0mm	55
1268	DFI	Implante Dual Fit D3.75mm L8.0mm	55
1270	DFI	Implante Dual Fit D4.2mm L10.0mm	55
1271	DFI	Implante Dual Fit D4.2mm L11.5mm	55

LISTA DE PRODUCTOS Y REF. NO.

NÚMERO DE REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁGINA NO.
1273	DFI	Implante Dual Fit D4.2mm L13.0mm	55
1276	DFI	Implante Dual Fit D4.2mm L16.0mm	55
1278	DFI	Implante Dual Fit D4.2mm L8.0mm	55
1280	DFI	Implante Dual Fit D3.3mm L10.0mm	55
1281	DFI	Implante Dual Fit D3.3mm L11.5mm	55
1283	DFI	Implante Dual Fit D3.3mm L13.0mm	55
1286	DFI	Implante Dual Fit D3.3mm L16.0mm	55
1288	DFI	Implante Dual Fit D3.3mm L8.0mm	55
1290	DFI	Implante Dual Fit D5.0mm L10.0mm	55
1291	DFI	Implante Dual Fit D5.0mm L11.5mm	55
1293	DFI	Implante Dual Fit D5.0mm L13.0mm	55
1296	DFI	Implante Dual Fit D5.0mm L16.0mm	55
1298	DFI	Implante Dual Fit D5.0mm L8.0mm	55
1300	SPI	Implante Spiral D3.3mm L10.0mm	50
1301	SPI	Implante Spiral D3.3mm L11.5mm	50
1303	SPI	Implante Spiral D3.3mm L13.0mm	50
1306	SPI	Implante Spiral D3.3mm L16.0mm	50
1308	SPI	Implante Spiral D3.3mm L8.0mm	50
1330	SPI	Implante Spiral D4.2mm L10.0mm	50
1331	SPI	Implante Spiral D4.2mm L11.5mm	50
1333	SPI	Implante Spiral D4.2mm L13.0mm	50
1336	SPI	Implante Spiral D4.2mm L16.0mm	50
1338	SPI	Implante Spiral D4.2mm L8.0mm	50
1340	SPI	Implante Spiral D5.0mm L10.0mm	50
1341	SPI	Implante Spiral D5.0mm L11.5mm	50
1343	SPI	Implante Spiral D5.0mm L13.0mm	50
1346	SPI	Implante Spiral D5.0mm L16.0mm	50
1348	SPI	Implante Spiral D5.0mm L8.0mm	50
1350	SPI	Implante Spiral D3.75mm L10.0mm	50
1351	SPI	Implante Spiral D3.75mm L11.5mm	50
1353	SPI	Implante Spiral D3.75mm L13.0mm	50
1356	SPI	Implante Spiral D3.75mm L16.0mm	50
1358	SPI	Implante Spiral D3.75mm L8.0mm	50
1360	SPI	Implante Spiral D6.0mm L10.0mm	50
1361	SPI	Implante Spiral D6.0mm L11.5mm	50
1363	SPI	Implante Spiral D6.0mm L13.0mm	50
1368	SPI	Implante Spiral D6.0mm L8.0mm	50
1420	ATID	Alpha-Tec Implante Dual D3.75mm L10.0mm	54
1421	ATID	Alpha-Tec Implante Dual D3.75mm L11.5mm	54
1423	ATID	Alpha-Tec Implante Dual D3.75mm L13.0mm	54
1428	ATID	Alpha-Tec Implante Dual D3.75mm L8.0mm	54
1430	ATID	Alpha-Tec Implante Dual D4.2mm L10.0mm	54
1431	ATID	Alpha-Tec Implante Dual D4.2mm L11.5mm	54
1433	ATID	Alpha-Tec Implante Dual D4.2mm L13.0mm	54
1438	ATID	Alpha-Tec Implante Dual D4.2mm L8.0mm	54

LISTA DE PRODUCTOS Y REF. NO.

NÚMERO DE REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁGINA NO.
1440	ATID	Alpha-Tec Implante Dual D5.0mm L10.0mm	54
1441	ATID	Alpha-Tec Implante Dual D5.0mm L11.5mm	54
1443	ATID	Alpha-Tec Implante Dual D5.0mm L13.0mm	54
1446	ATID	Alpha-Tec Implante Dual D5.0mm L6.0mm	54
1448	ATID	Alpha-Tec Implante Dual D5.0mm L8.0mm	54
3401	HA-D-4-CH-1.5-CS	Pilar de cicatrización D4 L1.5 CS	26
3402	HA-D-4-CH-2.5-CS	Pilar de cicatrización D4 L2.5 CS	26
3403	HA-D-4-CH-3.5-CS	Pilar de cicatrización D4 L3.5 CS	26
3404	HA-D-4-CH-4.5-CS	Pilar de cicatrización D4 L4.5 CS	26
3405	HA-D-4-CH-5.5-CS	Pilar de cicatrización D4 L5.5 CS	26
3407	HA-D-4.9-CH-1.5-CS	Pilar de cicatrización D4.9 L1.5 CS	26
3408	HA-D-4.9-CH-2.5-CS	Pilar de cicatrización D4.9 L2.5 CS	26
3409	HA-D-4.9-CH-3.5-CS	Pilar de cicatrización D4.9 L3.5 CS	26
3410	HA-D-4.9-CH-4.5-CS	Pilar de cicatrización D4.9 L4.5 CS	26
3411	HA-D-4-CH-5.5-CS	Pilar de cicatrización D4.9 L5.5 CS	26
3412	HA-D-6.2-CH-1.5-CS	Pilar de cicatrización D6.2 L1.5 CS	26
3413	HA-D-6.2-CH-2.5-CS	Pilar de cicatrización D6.2 L2.5 CS	26
3613	TLABCC-CHC	Pilar de fundición de cromo cobalto - CHC	39
3614	TLABCC-R-CHC	Pilar de fundición de cromo cobalto rotacional - CHC	39
3450	SCTT-CS	Transfer de bandeja cerrada	27
3451	LCTT-CS	Transfer de bandeja cerrada	27
3455	RCTT-CS	Transfer de bandeja cerrada	27
3456	RCTTS-CS	Transfer de bandeja cerrada	27
3459	IA-CS	Análogo de implante CS	27
3501	TLA-H-1.5-CS	Pilar de titanio recto H1.5mm CS	28
3502	TLA-H-2.5-CS	Pilar de titanio recto H2.5mm CS	28
3503	TLA-H-3.5-CS	Pilar de titanio recto H3.5mm CS	28
3504	TLA-H-4.5-CS	Pilar de titanio recto H4.5mm CS	28
3511	TLA-15-H-1.5-CS	Pilar angulado 15° CH1.5 CS	28
3512	TLA-15-H-2.5-CS	Pilar angulado 15° CH2.5 CS	28
3514	TLA-25-H-1.5-CS	Pilar angulado 25° CH1.5 CS	28
3515	TLA-25-H-2.5-CS	Pilar angulado 25° CH2.5 CS	28
3532	TA-AR-CS	Pilar temporario de titatio anti-rotacional	28
3533	TA-R-CS	Pilar temporario de titatio rotacional	28
3710	AA-0.75-CS	AlphaLoC Kit H 0.75 mm CS	32
3711	AA-1.5-CS	AlphaLoC Kit H 1.5 mm CS	32
3712	AA-2.5-CS	AlphaLoC Kit H 2.5 mm CS	32
3713	AA-3.5-CS	AlphaLoC Kit H 3.5 mm CS	32
3801	ITD2.5 S CS	Destornillador corto de inserción de implante	18, 26
3803	ITD-2.5 L-CS	Destornillador largo de inserción de implante	18, 26
3804	IT-2.5-SM-CS	Destornillador corto para contra ángulo 2.5mm CS	18, 26
3805	IT-2.5-LM-CS	Destornillador largo para contra ángulo 2.5mm CS	18, 26
3806	MITD-2.5-CS	Destornillador manual 2.5mm CS	18, 26
3832	TB-0.75-AR-CS	Ti-Base Recto CAD/CAM para restauraciones sobre implantes CS	34
3833	TB-0.75-R-CS	Ti-Base Recto CAD/CAM para restauraciones sobre implantes CS	34

LISTA DE PRODUCTOS Y REF. NO.

NÚMERO DE REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁGINA NO.
3837	IOSB-CS	Body scan de doble uso CAD/CAM para restauraciones sobre implantes CS	34
3838	AN-PM-CS	Análogo de implante CS	34
3840	TB-1.5-AR-CS	Ti-Base Recto CAD/CAM para restauraciones sobre implantes CS	34
3841	TB-1.5-R-CS	Ti-Base Recto CAD/CAM para restauraciones sobre implantes CS	34
3842	TB-2.5-AR-CS	Ti-Base Recto CAD/CAM para restauraciones sobre implantes CS	34
3843	TB-2.5-R-CS	Ti-Base Recto CAD/CAM para restauraciones sobre implantes CS	34
3846	CoCr-AR-CHCS	Pilar de fundición CoCr AR CS	27
3847	CoCr-R-CHCS	Pilar de fundición CoCr R CS	27
3854	BA-PR-CS	Bloque pre-fresado CAD/CAM D11.5mm para restauración en implantes CS	34
3855	WBA-PF-CS	Bloque pre-fresado CAD/CAM D15.8mm para restauración en implantes CS	34
3856	CSTB-CS-SI	Ti-Base Recto CAD/CAM SIRONA para restauraciones sobre implantes CS	35
3857	CSSP-CS-SI	Poste de escaneado de doble uso CAD/CAM para restauraciones en implantes CS	35
3862	AU 17-1.5-CS	Pilar angulado Multi Unit 17° 1,5mm para restauraciones sobre implantes CS	29
3863	AU 17-2.5-CS	Pilar angulado Multi Unit 17° 2,5mm para restauraciones sobre implantes CS	29
3864	AU 17-3.5-CS	Pilar angulado Multi Unit 17° 3,5mm para restauraciones sobre implantes CS	29
3867	AU 30-1.5-CS	Pilar angulado Multi Unit 30° 1,5mm para restauraciones sobre implantes CS	29
3868	AU 30-2.5-CS	Pilar angulado Multi Unit 30° 2,5mm para restauraciones sobre implantes CS	29
3869	AU 30-3.5-CS	Pilar angulado Multi Unit 30° 3,5mm para restauraciones sobre implantes CS	29
3870	TCT-0.5-CS	Pilar TCT-N L0.5mm para restauración de hasta 30° en implantes CS	29
3871	TCT-1.5-CS	Pilar TCT-N L1.5mm para restauración de hasta 30° en implantes CS	29
3872	TCT-2.5-CS	Pilar TCT-N L2.5mm para restauración de hasta 30° en implantes CS	29
3876	HBC-H0.75-CS	HBC L0.5mm para la restauración de un solo implante en implantes CS	29
3877	HBC-H1.5-CS	HBC L1.5mm para la restauración de un solo implante en implantes CS	29
3878	HBC-H2.5-CS	HBC L2.5mm para la restauración de un solo implante en implantes CS	29
3883	IOSB-TCT-N-R	Body scan de doble uso para restauración de puentes para unidades múltiples	35, 47, 67
4014	HTW	Destornillador manual (adaptador para destornilladores de cabeza hexagonal de 6.35mm)	19
4052	HHS1.25	Destornillador manual hexagonal 1.25mm	20
4053	HHSS1.25	Destornillador manual hexagonal corto 1.25mm	20
4055	HTD 1.25	Destornillador hexagonal 1.25mm	20
4056	HTD 1.25 S	Destornillador hexagonal corto 1,25 mm	20
4057	HTD1.5	Destornillador hexagonal corto 1,5mm	20
4058	HTD1.5S	Destornillador hexagonal Pro corto 1,5mm	20
4059	HHS1.5	Destornillador hexagonal manual Pro 1.5mm	20
4060	HHL1.5	Destornillador hexagonal manual largo Pro 1.5mm	20
4061	HTD 1.25L	Destornillador hexagonal largo 1,25mm	20
4071	ITS 2.5/1.25	Destornillador hexagonal para contra ángulo corto 2,5/1,25 mm	19
4072	ITS 2.5	Destornillador hexagonal para contra ángulo corto 2,5 mm	19
4073	IT 2.5	Destornillador hexagonal para contra ángulo 2.5mm	19
4080	PDG	Guía de profundidad paralelismo	21
4081	PDGS	Guía de profundidad paralelismo corta	21
4082	PG	Guía de paralelismo	21
4100	IDG	Sonda de profundidad para implantes	21
4140	G-ITDL2.5	Destornillador de implante largo 2.5 mm	56, 19
4141	G-ITDM2.5	Destornillador de implante estándar 2.5 mm	56, 19
4142	G-ITDS2.5	Destornillador de implante corto 2.5 mm	56, 19

LISTA DE PRODUCTOS Y REF. NO.

NÚMERO DE REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁGINA NO.
4143	GITL2.5/1.25	Destornillador de implante para contra ángulo largo 2.5 / 1.25 mm	56, 19
4145	GITS2.5/1.25	Destornillador de implante para contra ángulo corto 2.5 / 1.25 mm	56, 19
4146	MITD2.5-IH	Destornillador manual para implante 2.5mm IH	56, 19
4147	MITD2.1 CHC	Destornillador manual para implante 2.1mm CHC	18, 38
4151	ITD 2.5	Destornillador hexagonal largo 2,5mm	19
4152	ITD 2.5 S	Destornillador hexagonal 2.5mm	19
4153	ITD 2.5 SS	Destornillador hexagonal corto 2,5mm	19
4161	IT 2.5M+	Destornillador hexagonal para contra ángulo 2.5 / 1.25mm	19
4165	HT 1.25M	Destornillador hexagonal para contra ángulo 1.25mm	20
4168	HT1.5	Destornillador hexagonal para contra ángulo Pro 1.5mm	20
4220	SDH	Destornillador quirúrgico	21
4240	DX	Extensión de fresa L17.5mm	17
4303	RB2.3	Fresa redonda D2.3mm	17
4304	RB3	Fresa redonda D3.0mm	17
4305	RB4	Fresa redonda D4.0mm	17
4550	BD2.0	Fresa recta Alpha_D2.0	16
4551	BD2.4	Fresa recta Alpha_D2.4	16
4552	BD2.8	Fresa recta Alpha_D2.8	16
4553	BD3.0	Fresa recta Alpha_D3.0	16
4554	BD3.2	Fresa recta Alpha_D3.2	16
4555	BD3.65	Fresa recta Alpha_D3.65	16
4556	BD4.1	Fresa recta Alpha_D4.1	16
4557	BD4.5	Fresa recta Alpha_D4.5	16
4558	BD4.8	Fresa recta Alpha_D4.8	16
4559	BD5.2	Fresa recta Alpha_D5.2	16
4560	BD5.8	Fresa recta Alpha_D5.8	16
4561	DS-A-L6	Tope para fresa Alpha A-D2.0-2.4 L6	15
4562	DS-A-L8	Tope para fresa Alpha A-D2.0-2.4 L8	15
4563	DS-A-L10	Tope para fresa Alpha A-D2.0-2.4 L10	15
4564	DS-A-L11.5	Tope para fresa Alpha A-D2.0-2.4 L11.5	15
4565	DS-A-L13	Tope para fresa Alpha A-D2.0-2.4 L13	15
4566	DS-B-L6	Tope para fresa Alpha B-D2.8-3.0 L6	15
4567	DS-B-L8	Tope para fresa Alpha B-D2.8-3.0 L8	15
4568	DS-B-L10	Tope para fresa Alpha B-D2.8-3.0 L10	15
4569	DS-B-L11.5	Tope para fresa AlphaB-D2.8-3.0 L11.5	15
4570	DS-B-L13	Tope para fresa Alpha B-D2.8-3.0 L13	15
4572	URT	Torquímetro universal 10-45Ncm	21
4573	DS-C-L6	Tope para fresa Alpha C-D3.2-3.65 L6	15
4574	DS-C-L8	Tope para fresa Alpha C-D3.2-3.65 L8	15
4575	DS-C-L10	Tope para fresa Alpha C-D3.2-3.65 L10	15
4576	DS-C-L11.5	Tope para fresa Alpha C-D3.2-3.65 L11.5	15
4577	DS-C-L13	Tope para fresa Alpha C-D3.2-3.65 L13	15
4578	DS-D-L6	Tope para fresa Alpha D-D4.1-4.5 L6	15
4579	DS-D-L8	Tope para fresa Alpha D-D4.1-4.5 L8	15
4580	DS-D-L10	Tope para fresa Alpha D-D4.1-4.5 L10	15

LISTA DE PRODUCTOS Y REF. NO.

NÚMERO DE REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁGINA NO.
4581	DS-D-L11.5	Tope para fresa Alpha D-D4.1-4.5 L11.5	15
4582	DS-D-L13	Tope para fresa AlphaD-D4.1-4.5 L13	15
4590	BSD2.0-2.4	Fresa escalonada Alpha 2.0/2.4	16
4592	BSD2.4-2.8	Fresa escalonada Alpha 2.8/2.8	16
4593	BSD2.8-3.0	Fresa escalonada Alpha 2.8/3.0	16
4594	BSD2.8-3.2	Fresa escalonada Alpha 2.8/3.2	16
4595	BSD3.2-3.65	Fresa escalonada Alpha 2.8/3.65	16
4596	BSD3.65-4.1	Fresa escalonada Alpha 2.8/4.1	16
4597	BSD4.1-4.5	Fresa escalonada Alpha 2.8/4.5	16
4598	BSD4.5-4.8	Fresa escalonada Alpha 2.8/4.8	16
4599	BSD4.8-5.2	Fresa escalonada Alpha 2.8/5.2	16
4611	MKB	Caja quirúrgica mini kit	12
4612	STOPPER KIT	Kit de topes (provisto de 20 topes)	15
4672	CS	Fresa avellanadora D2.7-5.9mm	17
4712C	MDRX1.5	Fresa de marcado 1.5/L16	17
4774	MINI KIT	Mini kit de fresas escalonadas	12
4775	MINI KIT	Mini kit de fresas escalonadas sin plato	12
4699	SKB	Caja de kit quirurgico	12
4867	AK0.5	AlphaLoC Kit 0.5mm	64
4868	AK1	AlphaLoC Kit 1mm	64
4869	AK2	AlphaLoC Kit 2mm	64
4870	AK3	AlphaLoC Kit 3mm	64
4871	AK4	AlphaLoC Kit 4mm	64
4872	AK5	AlphaLoC Kit 5mm	64
4875	AMPP	Paquete de repuesto AlphaLoC	32, 44, 64
4876	AMSTR	Cofias AlphaLoC Macho-Fuerte violeta (X4)	32, 44, 64
4877	AMSTA	Cofias AlphaLoC Macho-Estándar transparentes (X4)	32, 44, 64
4878	AMSOF	Cofias AlphaLoC Macho-Rosa (X4)	32, 44, 64
4879	AMESO	Cofias AlphaLoC Macho-Extra suave amarillo (X4)	32, 44, 64
4882	AML	Cofias AlphaLoC Macho-Laboratorio negras (X4)	33, 45, 65
4883	ABOS	Anillo espaciador AlphaLoC	33, 45, 65
4884	AIC	Cofia para impresión AlphaLoC (X4)	33, 45, 65
4885	AFA	Análogo hembra para AlphaLoC (X4)	33, 45, 65
4886	AIT	Herramienta de inserción AlphaLoC	33, 45, 65
4887	AET	Herramienta de extracción AlphaLoC	33, 45, 65
4940	DRT 4	Fresa trépano D4.0mm	17
4950	DRT 5	Fresa trépano D5.0mm	17
4951	CCTB-2.5	TiBase CAD/CAM para restauraciones de un solo diente sobre implantes IH	66
4952	CCTB-R-2.5	TiBase CAD/CAM para restauración de barras/puentes sobre implantes IH	66
4953	CCTB-CHC-2.5	TiBase CAD/CAM para restauraciones de un solo diente sobre implantes CHC	46
4954	CCTB-R-CHC-2.5	TiBase CAD/CAM para la restauración de puentes sobre implantes CHC	46
4980	CCTB-IH-SI	TiBase Sirona CAD/CAM para escaneado o restauración en implantes IH	67
4982	CCTB-CHC-SI	TiBase Sirona CAD/CAM para escaneado o restauración sobre implantes CHC	47
4984	CCSP-IH-SI	Poste de escaneado CAD/CAM Sirona para restauraciones en implantes IH	67
4985	CCSP-CHC-SI	Poste de escaneado CAD/CAM Sirona para restauraciones en implantes CHC	47

LISTA DE PRODUCTOS Y REF. NO.

NÚMERO DE REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁGINA NO.
4988	BA-PF-IH	Bloque pre-fresado CAD/CAM para restauraciones sobre implantes IH	66
4989	WBA-PF-IH	Bloque pre-fresado CAD/CAM para restauración en implantes IH	66
4990	BA-PF-CHC	Bloque pre-fresado CAD/CAM para restauración en implantes CHC	46
4994	S-DM-SR	Tornillo CAD / CAM para montaje directo para restauración en TCT-N	35, 47, 67
4995	AN-PM	Análogo CAD/CAM para modelos impresos para restauración en implantes IH	66
4996	AN-PM-CHC	Análogo CAD/CAM para modelos impresos para restauración en implantes CHC	46
5003	IOSB-TCT-N	Body scan de doble uso para laboratorio	35, 47, 67
5005	ACCTB	TiBase angulado CAD/CAM para restauración sobre implantes IH	66
5006	ACCTB	TiBase angulado CAD/CAM para restauración sobre implantes CHC	46
5007	WCCTB	TiBase CAD/CAM ancho para restauraciones sobre implantes IH	66
5008	WCCTB-R	TiBase CAD/CAM ancho R para la restauración de implantes IH	66
5019	SB-IH	Body scan de doble uso CAD/CAM para restauraciones en implantes IH	66
5024	CCTB	TiBase CAD/CAM para restauraciones de un solo diente sobre implantes IH	66
5025	CCTB-R	TiBase CAD/CAMpara restauración de barras/puentes sobre implantes IH	66
5026	CCTB-CHC	TiBase CAD/CAM- para restauraciones de un solo diente sobre implantes CHC	46
5027	CCTB-CHC-R	TiBase CAD/CAM para la restauración de puentes sobre implantes CHC	46
5028	TAC-TCT-N	Coping adhesivo CAD/CAM TCT-N para un solo diente	35, 47, 67
5029	TAC-TCT-N-R	Coping adhesivo CAD/CAMTCT-N para barra/puente	35, 47, 67
5030	TLA	Pilar de titanio recto	58
5031	ETLA	Pilar de titanio recto estético	40
5040	PLA	Pilar de plástico recto anti rotacional	61
5041	PLA-R	Pilar de plástico recto rotacional	61
5050	PLAS	Pilar de plástico recto delgado	61
5060	HLT	Transfer de bandeja cerrada	57
5061	HLTO	Transfer de bandeja abierta	57
5062	HLTLS	Transfer de bandeja abierta corta	57
5080	IA	Análogo de implante	57
5090	TLA15	Pilar angulado de titanio 15°	58
5091	TLA15B	Pilar angulado de titanio15° con hombro	58
5092	TLAL15	Pilar angulado de titanio 15°	58
5093	PLA15	Pilar angulado de plástico 15°	61
5094	ETLAL15	Pilar angulado de titanio largo estético 15°	60
5098	TLA15BB	Pilar angulado de titanio largo de 15° con hombro	58
5110	RS	Tornillo de recuperación	61
5121	STLAT	Tornillo de pilar Torqfit	61
5122	STLAS	Tornillo de pilar de titanio corto L8.3mm	61
5127	STLASH	Tornillo de pilar de titanio L7.6mm	61
5130	TLA25	Pilar angulado de titanio 25°	58
5131	ETLA25	Pilar angulado de titanio estético 25°	60
5134	TLAL25	Pilar angulado de titanio largo 25°	58
5136	TLA35	Pilar angulado de titanio 35°	58
5140	TLAL	Pilar recto largo de titanio	58
5150	TLAS	Pilar recto delgado de titanio	58
5155	ETLAS	Pilar estético largo delgado de titanio	60
5170	HLTS	Transfer de bandeia cerrada	57

LISTA DE PRODUCTOS Y REF. NO.

NÚMERO DE REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁGINA NO.
5171	HLTOS	Transfer de bandeja abierta	57
5182	TLAO2	Pilar de titanio Omni H2.0mm	58
5200	TLAC-AR	Pilar temporario de titanio anti-rotacional	59
5211	BTT-N	Analog para TCT-N	30, 35, 42, 47, 63, 67
5216	TTA-N	Pilar temporario de titanio Pro para TCT-N	31, 43, 63
5217	PST-N-AR	Calcinable anti-rotacional Pro para TCT-N	31, 43, 63
5218	PST-N	Calcinable anti-rotacional Pro para TCT-N	31, 43, 63
5220	TLAC-R	Pilar temporario de titanio rotacional	59
5221	TCT0.5-N	Pilar recto MultiUnit Pro L 0,5mm	62
5222	TCT1.5-N	Pilar recto MultiUnit Pro L 1,5mm	62
5223	TCT2.5-N	Pilar recto MultiUnit Pro L 2,5mm	62
5231	TST-N	Transfer de bandeja abierta Pro para TCT-N/AUC-TCT-N	30, 42, 36
5235	TS-N	Transfer de bandeja cerrada Pro para pilares TCT-N/TSA-N	30, 42, 36
5236	HCT4-N	Pilar de cicatrización Pro L4mm para TCT-N/AUC-TCT-N	30, 42, 36
5237	HCT6-N	Pilar de cicatrización Pro L6mm para TCT-N/AUC-TCT-N	30, 42, 36
5242	TCT-N 0.75 CHC	Pilar Pro TCT-N L0,75 mm para restauraciones de hasta 30°	43
5243	TCT-N 1.5 CHC	Pilar Pro TCT-N L1.5 mm para restauraciones de hasta 30°	43
5244	TCT-N 2.5 CHC	Pilar Pro TCT-N L2,5 mm para restauraciones de hasta 30°	43
5245	TCT-N 3.5 CHC	Pilar Pro TCT-N L3,5 mm para restauraciones de hasta 30°	43
5246	TCT-N 4.5 CHC	Pilar Pro TCT-N L4.5 mm para restauraciones de hasta 30°	43
5247	TCT-N 5.5 CHC	Pilar Pro TCT-N L5,5 mm para restauraciones de hasta 30°	43
5248	TCT-N-R	Transfer de bandeja abierta para TCT-N	30, 42, 63
5252	TCT3.5-N	Pilar recto MultiUnit Pro L 3,5mm	62
5253	TCT4.5-N	Pilar recto MultiUnit Pro L 4,5mm	62
5254	TCT5.5-N	Pilar recto MultiUnit Pro L 5,5mm	62
5280	IA5	Análogo de implante D5.0mm	57
5340	TLAW	Pilar de titanio recto ancho	58
5352	ETLASP1	Pilar recto estético de titanio H1mm	60
5353	ETLASP2	Pilar recto estético de titanio H2mm	60
5354	ETLASP3	Pilar recto estético de titanio H3mm	60
5355	ETLASP4	Pilar recto estético de titanio H4mm	60
5362	TLAO4	Pilar de titanio Omni H4.0mm	58
5364	HTLASP	Transfer plástico	27, 57
5366	TLASP1	Pilar recto de titanio H1.0mm	58
5367	TLASP2	Pilar recto de titanio H2.0mm	58
5368	TLASP3	Pilar recto de titanio H3.0mm	58
5369	TLASP4	Pilar recto de titanio H4.0mm	58
5401	TLAWP	Pilar recto de titanio perfil ancho	58
5402	TLAWPL	Pilar recto largo de titanio perfil ancho	58
5403	TLASSP	Pilar recto corto de titanio perfil delgado	58
5410	EAAS15	Pilar estético anatómico corto 15°	60
5411	EAA15	Pilar estético anatómico 15°	60
5412	EAAH15	Pilar estético anatómico angulado 15°	60
5413	EAAS25	Pilar estético anatómico corto 25°	60
5414	EAA25	Pilar estético anatómico 25°	60

LISTA DE PRODUCTOS Y REF. NO.

NÚMERO DE REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁGINA NO.
5415	EAAH25	Pilar estético anatómico 25°	60
5416	TPA 1	Pilar PEEK temporal recto H 1.0	59
5417	TPA 2	Pilar PEEK temporal recto H 2.0	59
5418	TPA 3	Pilar PEEK temporal recto H 3.0	59
5419	TPA15-1	Pilar PEEK temporal 15° H 1.0	59
5420	TPA15-2	Pilar PEEK temporal 15° H 2.0	59
5421	TPA15-3	Pilar PEEK temporal 15° H 3.0	59
5422	TPA25-1	Pilar PEEK temporal 25° H 1.0	59
5423	TPA25-2	Pilar PEEK temporal 25° H 2.0	59
5432	AU 17-1.5 HI	Pilar angulado Multi Unit 17° 1,5mm para restauraciones sobre implantes IH	62
5433	AU 17-2.5 HI	Pilar angulado Multi Unit 17° 2,5mm para restauraciones sobre implantes IH	62
5434	AU 17-3.5 HI	Pilar angulado Multi Unit 17° 3,5mm para restauraciones sobre implantes IH	62
5437	AU 30-1.5 HI	Pilar angulado Multi Unit 30° 1,5mm para restauraciones sobre implantes IH	62
5438	AU 30-2.5 HI	Pilar angulado Multi Unit 30° 2,5mm para restauraciones sobre implantes IH	62
5439	AU 30-3.5 HI	Pilar angulado Multi Unit 30° 3,5mm para restauraciones sobre implantes IH	62
6012	SFL-N	Transfer de bandeja abierta TCT-N / TSA-N	30, 42, 63
6040	HBC0.5	Conexión de base hexagonal L 0.5mm	62
6041	HBC1.5	Conexión de base hexagonal L 1.5mm	62
6042	HBC2.5	Conexión de base hexagonal L 2.5mm	62
6050	LS0.5	Tornillo para HBC L0.5mm (Parte del kit HBC)	62
6051	LS1.5	Tornillo para HBC L1.5mm (Parte del kit HBC)	62
6052	LS2.5	Tornillo para HBC L2.5mm (Parte del kit HBC)	62
6070	PST-AR	calcinable anti rotación (parte del kit HBC)	62
6092	SF-N	Tornillo de fijación SF-N	31, 43, 62
6093	SFT-N	Tornillo de fijación Torqfit SFT-N	31, 43, 62
6210	TB2	Retenedor de bola de titanio L2.0mm	64
6220	TB4	Retenedor de bola de titanio L4.0mm	64
6240	H	Estructura metálica para fijación de bolas	44, 64
6250	NC	Cofia de nylon estándar	44, 64
6251	NCT	Cofia de nylon con anillo de titanio	44, 64
6253	NCA	Cofia de nylon suave	44, 64
6260	TB0.5	Retenedor de bola de titanio L 0.5mm	64
6270	TB5	Retenedor de bola de titanio L5.0mm	64
6280	TB3	Retenedor de bola de titanio L3.0mm	64
6290	TB6	Retenedor de bola de titanio L6.0mm	64
6304	TBAA2	Retenedor de bola angulada de titanio L2.0mm	64
6306	TBAA3	Retenedor de bola angulada de titanio L3.0mm	64
6405	TLABCC	Pilar de fundición de cromo cobalto	61
6406	TLABCC-R	Pilar de fundición de cromo cobalto rotacional	15
65080	GSTK	Kit de nivel de entrada de cirugía guiada	15
65081	GSTK	Kit de extensión de nivel de entrada de cirugía guiada	15
65000	GSTK	GSTK kit para IH y CHC	15
65002	GSTK	GSTK kit para CS y CHC	15
65003	GSTK	Kit GSTK para CS, CHC y IH	15
66013	SLL	Funda maestra 5.5 para perforación guiada e inserción im-plantes	15

LISTA DE PRODUCTOS Y REF. NO.

NÚMERO DE REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁGINA NO.
66014	SLSE	Funda de fijación	15
65058	SLSA	Adaptador de funda 4.1	15
66012	SLS	Funda maestra 4.1 para perforar e insertar implantes	16
7301	ITD2.1L-CHC	Destornillador largo de implante 2.1mm CHC	16
7302	ITD2.1S-CHC	Destornillador corto de implante 2.1mm CHC	16
7303	IT2.1LM -CHC	Destornillador largo para contra ángulo 2.1mm CHC	16
7304	IT2.1SM -CHC	Destornillador corto para contra ángulo 2.1mm CHC	16
7305	ITD2.1-CHC	Destornillador estándar para implante 2.1mm CHC	16
7311	HSD3.4-2-CHC	Pilar de cicatrización D3.4 L2 CHC	16
7312	HSD3.4-3-CHC	Pilar de cicatrización D3.4 L3 CHC	16
7313	HSD3.4-5-CHC	Pilar de cicatrización D3.4 L5 CHC	16
7315	HSD3.8-2-CHC	Pilar de cicatrización D3.8 L2 CHC	12
7316	HSD3.8-3-CHC	Pilar de cicatrización D3.8 L3 CHC	15
7317	HSD3.8-5-CHC	Pilar de cicatrización D3.8 L5 CHC	17
7319	HSD4.2-2-CHC	Pilar de cicatrización D4.2 L2 CHC	17
7320	HSD4.2-3-CHC	Pilar de cicatrización D4.2 L3 CHC	12
7321	HSD4.2-5-CHC	Pilar de cicatrización D4.2 L5 CHC	12
7333	HLTS-CHC	Transfer de bandeja cerrada CHC	12
7335	HLTO-CHC	Transfer de bandeja abierta larga CHC	64
7338	IA-CHC	Análogo CHC	64
7345	STLA-CHC	Tornillo de pilar CHC	64
7350	ETLASP1-CHC	Pilar estético recto simple H1.0mm CHC	64
7351	ETLASP2-CHC	Pilar estético recto simple H2.0mm CHC	64
7352	ETLASP3 -CHC	Pilar estético recto simple H3.0mm CHC	64
7353	ETLASP4-CHC	Pilar estético recto simple H4.0mm CHC	32, 44, 64
7356	ETLAS3.2-CHC	Pilar estético delgado estándar D3.2 CHC	32, 44, 64
7357	ETLAS3.6-CHC	Pilar estético estándar D3.6 CHC	32, 44, 64
7358	TLAS4.0-CHC	Pilar estándar D4.0 CHC	32, 44, 64
7360	ETLA15-CHC	Pilar estético angulado de titanio 15° CHC	32, 44, 64
7361	ETLAL15-CHC	Pilar estético angulado largo de titanio 15° CHC	33, 45, 65
7362	ETLA25-CHC	Pilar estético angulado de titanio 25° CHC	33, 45, 65
7363	EA15-1.5-CHC	Pilar angulado anatómico 15° titanio H1.5mm CHC	33, 45, 65
7364	EA15-2.5-CHC	Pilar angulado anatómico 15° titanio H2.5mm CHC	33, 45, 65
7365	EA15-3.5-CHC	Pilar angulado anatómico 15° titanio H3.5mm CHC	33, 45, 65
7366	EA25-1.5-CHC	Pilar angulado anatómico 25° titanio H1.5mm CHC	33, 45, 65
7367	EA25-2.5-CHC	Pilar angulado anatómico 25° titanio H2.5mm CHC	17
7368	EA25-3.5-CHC	Pilar angulado anatómico 25° titanio H3.5mm CHC	17
7370	ETWASP1-CHC	Pilar estético recto ancho h1.0mm CHC	66
7371	ETWASP2-CHC	Pilar estético recto ancho h2.0mm CHC	40
7372	ETWASP3-CHC	Pilar estético recto ancho h3.0mm CHC	40
7373	ETWASP4-CHC	Pilar estético recto ancho h4.0mm CHC	40
7374	ETWASP5-CHC	Pilar estético recto ancho h5.0mm CHC	40
7383	ETLAS4.0-CHC	Pilar estético estandar D4.0 CHC	40
7400	RS-CHC	Tornillo de recuperación CHC	41
7403	TB1-CHC	Retenedor de bola de titanio 2,5mm L 1mm CHC	44

LISTA DE PRODUCTOS Y REF. NO.

NÚMERO DE REFERENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PÁGINA NO.
7404	TB2-CHC	Retenedor de bola de titanio 2,5mm L 2mm CHC	44
7405	TB3-CHC	Retenedor de bola de titanio 2,5mm L 3mm CHC	44
7406	TB4-CHC	Retenedor de bola de titanio 2,5mm L 4mm CHC	44
7407	TB5-CHC	Retenedor de bola de titanio 2,5mm L 5mm CHC	44
7470	AK0.5-CHC	Kit AlphaLoC 0,5mm para restauración en implantes CHC	44
7471	AK1-CHC	Kit AlphaLoC 1mm para restauración en implantes CHC	44
7472	AK2-CHC	Kit AlphaLoC 2mm para restauración en implantes CHC	44
7473	AK3-CHC	Kit AlphaLoC 3mm para restauración en implantes CHC	44
7474	AK4-CHC	Kit AlphaLoC 4mm para restauración en implantes CHC	44
7475	AK5-CHC	Kit AlphaLoC 5mm para restauración en implantes CHC	44
7482	AU 17-1.5 CHC	Pilar angulado Multi Unit 17° 1,5mm para restauraciones sobre implantes CHC	42
7483	AU 17-2.5 CHC	Pilar angulado Multi Unit 17° 2,5mm para restauraciones sobre implantes CHC	42
7484	AU 17-3.5 CHC	Pilar angulado Multi Unit 17° 3,5mm para restauraciones sobre implantes CHC	42
7487	AU 30-1.5 CHC	Pilar angulado Multi Unit 30° 1,5mm para restauraciones sobre implantes CHC	42
7488	AU 30-2.5 CHC	Pilar angulado Multi Unit 30° 2,5mm para restauraciones sobre implantes CHC	42
7489	AU 30-3.5 CHC	Pilar angulado Multi Unit 30° 3,5mm para restauraciones sobre implantes CHC	42

Garantía Alpha-Bio Tec

Alpha-Bio Tec se esfuerza continuamente por actualizar y mejorar sus productos; Por lo tanto, nos reservamos el derecho de modificar diseños, productos y/o técnicas cuando creamos que está justificado. También nos reservamos el derecho de cambiar los precios, las políticas y los términos sin previo aviso. La disponibilidad de los productos puede variar de un país a otro. Algunos productos pueden no estar disponibles en los Estados Unidos.

Garantía: Alpha-Bio Tec no otorga ninguna garantía, expresa o implícita, excepto que todos los productos estarán libres de defectos en los materiales y/o mano de obra. Esta garantía se aplica al comprador original. En el caso de un defecto en el producto, notifique a Alpha-Bio Tec por escrito antes de devolver el producto.

Alpha-Bio Tec, a su discreción, reparará, reemplazará o emitirá un crédito por mercancía defectuosa.
El comprador asume todos los riesgos y responsabilidades derivadas del uso de estos productos, ya sea que se utilicen por separado o junto con productos que no sean de fabricación de Alpha-Bio Tec.

Alpha-Bio Tec recomienda encarecidamente la finalización de la formación de postgrado en implantes y el cumplimiento de todos los procedimientos técnicos e instrucciones. La ley federal permite la venta de estos productos a médicos y odontólogos autorizados. Los productos en este catálogo pueden estar protegidos por más de una patente.

Copyright © Alpha-Bio Tec Ltd. **Todos los derechos reservados. Importante - Lea las instrucciones antes de usar.**

Lifetime WARRANTY NUESTRA GARANTÍA - SU TRANQUILIDAD

Los productos de alta calidad de Alpha-Bio Tec cumplen con los estrictos estándares internacionales.
Por este motivo, podemos proporcionarle una garantía de por vida para nuestra amplia gama de implantes (sin incluir los implantes temporarios). En cualquier caso de un defecto en el implante, rechazo del implante, fractura o contaminación del producto, sujeto a la presentación de un informe de reclamos, Alpha-Bio Tec reemplazará la mercancía defectuosa.

Garantía: Alpha-Bio Tec garantiza que todos los implantes estarán libres de defectos en los materiales y/o mano de obra. Esta garantía se aplica únicamente al comprador original. No hay garantías, expresas o implícitas, excepto esta garantía, que se otorga en lugar de cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluida cualquier garantía implícita de idoneidad para un propósito particular.

Importante - Lea las instrucciones antes de usar.
Un informe de reclamos está disponible en el servicio al cliente de Alpha-Bio Tec y se enviará a pedido.

995-0003 R9 / 08.2019

Simplantology

Simplantología, en todo lo que hacemos.

Los productos de Alpha-Bio Tec están autorizados para su comercialización en los EE. UU.* y tienen el marcado CE de acuerdo con la Directiva del Consejo 93/42/CEE. Alpha-Bio Tec's cumple con la norma EN ISO 13485: 2016. La disponibilidad de los productos puede variar de un país a otro.

instagram.com/alphabio.la linkedin.com/company/alpha-bio-tec youtube.com/user/AlphaBioTec/